



T.C.  
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Rektörlük



Sayı : E-17886791-100-2500042487  
Konu : MUNTEAM 2025 Yılı Analiz ve Test  
Fiyatları

20.08.2025

DAĞITIM YERLERİNE

Üniversitemiz Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce (MUNTEAM) 2025 yılı içerisinde uygulanacak hizmet fiyatları ve prosedürü ile ilgili fiyat listesi, analiz ve test istek formu ve katalog yazımız ekinde sunulmuş olup; Üniversiteniz ilgili birimlerine duyurulması hususunda;  
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Kenan PEKER  
Rektör

Ek:

- 1- MUNTEAM Hizmet Fiyatları 2025
- 2- Katalog
- 3- Analiz ve Test İstek Formu

DAĞITIM LİSTESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 23934413  
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 60061509  
ADANA ALPARSLAN TÜRKİŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ  
REKTÖRLÜĞÜ 83412458  
ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 87324094  
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 38907166  
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 74790171  
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 11054618  
ALANYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 19214183  
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 19473914  
ANKA TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 20331894  
AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 30640013  
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 41352484  
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 43202761  
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53950545

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 934DFF7

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/munzur-universitesi-ebys>

Adres: Aktuluk Mah. Üniversite Yerleşkesi Merkez / Tunceli

Bilgi için :

Ali Can Dikmen

Telefon No: (0 428) 2132348

Faks No:

Memur

e-Posta: [universite@munzur.edu.tr](mailto:universite@munzur.edu.tr)

İnternet Adresi:

Telefon No:

(0 428) 2131794

Kep Adresi: [munzuruniversitesi@hs01.kep.tr](mailto:munzuruniversitesi@hs01.kep.tr)

Direkt Hat:



ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 70561447  
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 81477236  
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 96136591  
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 12254029  
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 11811414  
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 12606850  
BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 28962623  
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 29010975  
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 31906847  
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 34958711  
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 36056402  
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 43285779  
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 45152895  
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 46639018  
BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 52300778  
ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181  
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 60379008  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 67241463  
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 69268593  
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 75513667  
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 79879538  
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 80431747  
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 81858953  
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 84391427  
BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 85269548  
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 91694447  
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 93265200  
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 94352752  
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 12301657  
HALIÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 12878320  
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 14564629  
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 15705228  
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 22686390  
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 31115241  
IŞIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 32760440  
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 34265670  
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 35853172  
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 37077861  
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 38689832  
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 39089344  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 39985474  
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 41848614  
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 45379966  
HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 45769962  
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 45778635  
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 46046230  
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 47457363  
FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 50716828  
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 51035907  
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 52178233

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 934DFF7

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/munzur-universitesi-ebys>

Adres: Aktuluk Mah. Üniversite Yerleşkesi Merkez / Tunceli

Bilgi için :

Ali Can Dikmen

Telefon No: (0 428) 2132348

Faks No:

Memur

e-Posta: [universite@munzur.edu.tr](mailto:universite@munzur.edu.tr)

İnternet Adresi:

Telefon No:

(0 428) 2131794

Kep Adresi: [munzuruniversitesi@hs01.kep.tr](mailto:munzuruniversitesi@hs01.kep.tr)

Direkt Hat:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 57514100  
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 57730304  
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 60793471  
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 62365171  
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 62899674  
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 64922182  
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 69396709  
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 69707128  
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 71130526  
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 71395021  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 74397875  
HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 76244175  
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 76836208  
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 80686208  
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 83204037  
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 84994412  
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 85748827  
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 85986041  
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 87841438  
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 88346758  
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 88813803  
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 89026508  
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 92662996  
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 92979750  
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 96001039  
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 96157012  
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 10059539  
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 11197185  
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 12483425  
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 14608901  
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 17578975  
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 18779581  
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 23370156  
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 23491112  
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 24129208  
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 26228097  
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 26626960  
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 27566166  
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 28830459  
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 29533901  
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 30044775  
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 30182376  
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 30785963  
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 31675095  
SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 32877067  
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 33121373  
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 33145098  
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 33490967  
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 33812460  
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 35121374

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 934DFF7

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/munzur-universitesi-ebys>

Adres: Aktuluk Mah. Üniversite Yerleşkesi Merkez / Tunceli

Bilgi için :

Ali Can Dikmen

Telefon No: (0 428) 2132348

Faks No:

Memur

e-Posta: [universite@munzur.edu.tr](mailto:universite@munzur.edu.tr)

İnternet Adresi:

Telefon No:

(0 428) 2131794

Kep Adresi: [munzuruniversitesi@hs01.kep.tr](mailto:munzuruniversitesi@hs01.kep.tr)

Direkt Hat:

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 35138650  
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 35950415  
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 35955870  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 35980450  
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 36716362  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 36760517  
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 36889312  
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ 37668103  
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 37953592  
TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 37970082  
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 39769797  
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 40272810  
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 42384932  
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 43660838  
ÖZYEGİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 44121234  
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 44353324  
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 44706518  
KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 46409256  
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 46418926  
MEF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 47749965  
KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 47928794  
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 49979045  
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 51612028  
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 52606142  
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53822972  
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53875521  
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53938333  
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 55568171  
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 56665618  
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 58565088  
TED ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59143790  
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59518453  
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59760180  
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Genel Sekreterlik) 61509119  
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 61882530  
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 62342504  
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 65836846  
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 68373721  
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 69694425  
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 70531793  
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 70875988  
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 71457743  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ 74555795  
ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 77158231  
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 77366270  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 78633602  
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 78678999  
SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 79909130  
TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 80706068  
SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 80855585

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 934DFF7

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/munzur-universitesi-ebys>

Adres: Aktuluk Mah. Üniversite Yerleşkesi Merkez / Tunceli

Bilgi için :

Ali Can Dikmen

Telefon No: (0 428) 2132348

Faks No:

Memur

e-Posta: [universite@munzur.edu.tr](mailto:universite@munzur.edu.tr)

İnternet Adresi:

Telefon No:

(0 428) 2131794

Kep Adresi: [munzuruniversitesi@hs01.kep.tr](mailto:munzuruniversitesi@hs01.kep.tr)

Direkt Hat:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 81234794  
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 81652733  
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 82735415  
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 83892146  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 85171946  
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 87345159  
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 87750021  
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 88113471  
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 89480013  
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 89636268  
TARSUS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 91298975  
KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 92819890  
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 93763328  
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 97214440  
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 97429853  
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 98710917  
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 99043191  
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 99132376  
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 99650833  
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 77300296  
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 64714626  
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 40839667  
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 10081436  
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 11884093  
TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 13390371  
UFUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 14853754  
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 21095650  
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 30694532  
TÜRKİYE ULUSLARARASI İSLAM, BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ  
REKTÖRLÜĞÜ 36756681  
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 50532705  
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667  
YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59131787  
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59441486  
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 60560713  
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 75548883  
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 85873635

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 934DFF7

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/munzur-universitesi-ebys>

Adres: Aktuluk Mah. Üniversite Yerleşkesi Merkez / Tunceli

Bilgi için :

Ali Can Dikmen

Telefon No: (0 428) 2132348

Faks No:

Telefon No:

(0 428) 2131794

e-Posta: [universite@munzur.edu.tr](mailto:universite@munzur.edu.tr)

İnternet Adresi:

Direkt Hat:

Kep Adresi: [munzuruniversitesi@hs01.kep.tr](mailto:munzuruniversitesi@hs01.kep.tr)

# MUNZUR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

## HİZMET KALEMLERİNİN FİYATLARI

**NOT:** Laboratuvar analizlerinde kurum içi kullanıcılara %50 fiyat avantajı uygulanacaktır.

### NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMLERİ BÜNYESİNDE YAPILAN ANALİZ VE TESTLER

**Tablo 15:**

| CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME BİRİMİ |                         |                                                                                                                                                                                             |                         |                |                           |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|
| ANALİZ/TEST KODU                          | ANALİZ/TEST ADI         | METOT/AÇIKLAMA                                                                                                                                                                              | HİZMET SÜRESİ (İŞ GÜNÜ) | NUMUNE MİKTARI | HİZMET BEDELİ (KDV HARİÇ) |
| CEVHER HAZIRLAMA                          |                         |                                                                                                                                                                                             |                         |                |                           |
| CH-1                                      | Kaba Kırma (-10 cm)     | Kırılacak numunenin kırma işlemi sonrasında tamamı 10 cm'nin altına indirilir. Numunenin tane boyutu 10 cm üzerinde olmalıdır.                                                              | 2 Gün                   | 5- 50 Kg       | 120,00 TL/Kg              |
| CH-2                                      | Orta Kırma (-5 cm)      | Kırılacak numunenin kırma işlemi sonrasında tamamı 5 cm'nin altına indirilir. Numunenin en iri tane boyutu 10 cm üzerinde ise CH-1 bedeli ayrıca ilave edilecektir.                         | 2 Gün                   | 5- 50 Kg       | 150,00 TL/Kg              |
| CH-3                                      | İnce Kırma (-1 cm)      | Kırılacak numunenin kırma işlemi sonrasında tamamı 1 cm'nin altına indirilir. Numunenin en iri tane boyutu 5 cm üzerinde ise CH-2 bedeli ayrıca ilave edilecektir.                          | 2 Gün                   | 5- 50 Kg       | 170,00 TL/Kg              |
| CH-4                                      | Daha İnce Kırma (-5 mm) | Kırılacak numunenin kırma işlemi sonrasında tamamı 5 mm'nin altına indirilir. Bu kırma işleminden önce numunenin en iri tane boyutu 1 cm üzerinde ise CH-3 bedeli ayrıca ilave edilecektir. | 2 Gün                   | 5- 50 Kg       | 190,00 TL/Kg              |
| CH-5                                      | Çok İnce Kırma (-1 mm)  | Kırılacak numunenin kırma işlemi sonrasında tamamı 1 mm'nin altına indirilir. Bu kırma işleminden önce numunenin en iri tane boyutu 5 mm üzerinde ise CH-4 bedeli ayrıca ilave edilecektir. | 2 Gün                   | 5- 50 Kg       | 220,00 TL/Kg              |
| CH-6                                      | Kuru Öğütme (-0,5 mm)   | Öğütülecek numune tane iriliği 5 mm'nin altında olmalıdır. Numune 5 mm'nin üzerinde ise uygun boyuta getirmek için yapılacak analiz/test hizmet bedelleri ayrıca ilave edilecektir.         | 5 Gün                   | 5- 50 Kg       | 340,00 TL/Kg              |

|       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|------------------|
| CH-7  | Çok İnce Kuru Öğütme (-0,1 mm)                                    | Analiz numunesi hazırlamak için yapılır. Öğütülecek numune tane iriliği 5 mm'nin altında olmalıdır. Numune 5 mm'nin üzerinde ise uygun boyuta getirmek için yapılacak analiz/test hizmet bedelleri ayrıca ilave edilecektir.                                                                                              | 5 Gün  | 1- 20 Kg                               | 500,00 TL/Kg     |
| CH-8  | Yaş Öğütme (-0,5 mm)                                              | Öğütülecek numune tane iriliği 5 mm'nin altında olmalıdır. Numune 5 mm'nin üzerinde ise uygun boyuta getirmek için yapılacak analiz/test hizmet bedelleri ayrıca ilave edilecektir.                                                                                                                                       | 5 Gün  | 1- 20 Kg                               | 420,00 TL/Kg     |
| CH-9  | Kuru Eleme (+ 5 mm)                                               | Eleme işlemi tek elek ile yapılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 Gün  | 1- 30 Kg                               | 150,00 TL/Kg     |
| CH-10 | Kuru Eleme (- 5 + 0,074 mm)                                       | Eleme işlemi tek elek ile yapılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 Gün  | 1- 30 Kg                               | 190,00 TL/Kg     |
| CH-11 | Yaş Eleme (+ 5 mm)                                                | Eleme işlemi tek elek ile yapılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 Gün  | 1- 30 Kg                               | 220,00 TL/Kg     |
| CH-12 | Yaş Eleme (- 5 +0,5 mm)                                           | Eleme işlemi tek elek ile yapılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 Gün  | 1- 30 Kg                               | 250,00 TL/Kg     |
| CH-13 | Yaş Eleme (- 0,5 mm)                                              | Eleme işlemi tek elek ile yapılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 Gün  | 1- 30 Kg                               | 340,00 TL/Kg     |
| CH-14 | Bölme ve Temsili Numune Alma                                      | İşlem, -30 mm tane iriliği içindir. Temsiliyeti bozmadan azaltma ve/veya bölme işlemi yapılır. Numunenin uygun boyuta getirilmesi için yapılacak işlem hizmet bedelleri ayrıca ilave edilecektir.                                                                                                                         | 5 Gün  | -30 mm tane boyutunda 1 - 50 kg numune | 550,00 TL/Kg     |
| CH-15 | Elek Analizi (300 mikron üstü; Kuru) (Tane Boyu Dağılımı Analizi) | 300 mikron elek ile yapılacak elemeleri kapsar. Hizmetin bedeli fraksiyon sayısı olarak alınır. Talep edilen elek adedinden bir fazlası fraksiyon sayısını belirler.                                                                                                                                                      | 5 Gün  | 0.15-2 mm öğütülmüş 1- 5 kg numune     | 300,00 TL/Kg     |
| CH-16 | Elek Analizi (300 mikron altı; Kuru) (Tane Boyu Dağılımı Analizi) | 300 mikron elek ile yapılacak elemeleri kapsar. Hizmetin bedeli fraksiyon sayısı olarak alınır. Talep edilen elek adedinden bir fazlası fraksiyon sayısını belirler.                                                                                                                                                      | 5 Gün  | 0.15-2 mm öğütülmüş 1- 5 kg numune     | 350,00 TL/Kg     |
| CH-17 | Elek Analizi (300 mikron üstü; Kuru) (Tane Boyu Dağılımı Analizi) | 300 mikron elek ile yapılacak elemeleri kapsar. Hizmetin bedeli fraksiyon sayısı olarak alınır. Talep edilen elek adedinden bir fazlası fraksiyon sayısını belirler.                                                                                                                                                      | 5 Gün  | 0.15-2 mm öğütülmüş 1- 5 kg numune     | 500,00 TL/Kg     |
| CH-18 | Elek Analizi (300 mikron altı; Yaş)(Tane Boyu Dağılımı Analizi)   | 300 mikron elek ile yapılacak elemeleri kapsar. Hizmetin bedeli fraksiyon sayısı olarak alınır. Talep edilen elek adedinden bir fazlası fraksiyon sayısını belirler.                                                                                                                                                      | 5 Gün  | 0.15-2 mm öğütülmüş 1- 5 kg numune     | 550,00 TL/Kg     |
| CH-19 | Sallantılı Masa                                                   | Çalışılan her fraksiyon boyutu bir deney sayılacaktır. Numune uygun boyutta değil ise uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin hizmet bedeli ayrıca ilave edilecektir. Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse bu hizmet bedelleri ayrıca ilave edilecektir. | 10 Gün | 10- 50 Kg                              | 1750,00 TL/Deney |

|       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|
| CH-20 | Jig                                                             | Çalışılan her fraksiyon boyutu bir deney sayılacaktır. Numune uygun boyutta değil ise uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin hizmet bedeli ayrıca ilave edilecektir. Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse bu hizmet bedelleri ayrıca ilave edilecektir.  | 10 Gün | 25- 50 Kg | 1750,00 TL/Deney  |
| CH-21 | Multi Gravite Seperatör (MGS)                                   | Çalışılan her fraksiyon boyutu bir deney sayılacaktır. Numune uygun boyutta değil ise uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin hizmet bedeli ayrıca ilave edilecektir. Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse bu hizmet bedelleri ayrıca ilave edilecektir.  | 10 Gün | 10- 50 Kg | 3.000,00 TL/Deney |
| CH-22 | Falcon Yarı Kesikli Gravite Seperatör (Konsantratör)            | Çalışılan her fraksiyon boyutu bir deney sayılacaktır. Numune uygun boyutta değil ise uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin hizmet bedeli ayrıca ilave edilecektir. Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse bu hizmet bedelleri ayrıca ilave edilecektir.  | 10 Gün | 10- 50 Kg | 1750,00 TL/Deney  |
| CH-23 | Knelson Yerçekimi Konsantratörü                                 | Çalışılan her fraksiyon boyutu bir deney sayılacaktır. Numune uygun boyutta değil ise uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin hizmet bedeli ayrıca ilave edilecektir. Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse bu hizmet bedelleri ayrıca ilave edilecektir.  | 10 Gün | 10- 50 Kg | 1500,00 TL/Deney  |
| CH-24 | Düşük Alan Şiddetli Kuru Manyetik Ayırma (Laboratuvar Ölçekte)  | Çalışılan her fraksiyon boyutu bir deney sayılacaktır. Numune uygun boyutta değil ise uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin hizmet bedeli ayrıca ilave edilecektir. Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse bu hizmet bedelleri ayrıca ilave edilecektir.  | 10 Gün | 10- 50 Kg | 1500,00 TL/Deney  |
| CH-25 | Düşük Alan Şiddetli Yaş Manyetik Ayırma (Laboratuvar Ölçekte)   | Çalışılan her fraksiyon boyutu bir deney sayılacaktır. Numune uygun boyutta değil ise uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin hizmet bedeli ayrıca ilave edilecektir. Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse bu hizmet bedelleri ayrıca ilave edilecektir.  | 10 Gün | 10- 50 Kg | 2000,00 TL/Deney  |
| CH-26 | Yüksek Alan Şiddetli Kuru Manyetik Ayırma (Laboratuvar Ölçekte) | Çalışılan her fraksiyon boyutu bir deney sayılacaktır. Numune uygun boyutta değil ise, uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin hizmet bedeli ayrıca ilave edilecektir. Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse bu hizmet bedelleri ayrıca ilave edilecektir. | 10 Gün | 10- 50 Kg | 2150,00 TL/Deney  |
| CH-27 | Yüksek Alan Şiddetli Yaş Manyetik Ayırma (Laboratuvar Ölçekte)  | Çalışılan her fraksiyon boyutu bir deney sayılacaktır. Numune uygun boyutta değil ise uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin hizmet bedeli ayrıca ilave edilecektir. Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse bu hizmet bedelleri ayrıca ilave edilecektir.  | 10 Gün | 10- 50 Kg | 2000,00 TL/Deney  |

|                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|
| CH-28                   | Flotasyon Deneyi<br>(Laboratuvar Ölçekte)           | Deneyler, yalnız tam teknoloji çalışmaları kapsamında yapılır. Bir flotasyon deneyinin devamında yapılabilecek her bir temizleme deneyi ayrı bir deney sayılacaktır. Numunenin uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin hizmet bedeli ayrıca ilave edilecektir. Deney sonrasında yapılacak olan kimyasal ve mineralojik analiz/testlerin hizmet bedelleri ayrıca ilave edilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 Gün | 5 Kg     | 2100,00 TL/Deney      |
| CH-29                   | Filtrasyon (+147 mikron)                            | 147 mikron'dan daha iri malzemeler filtre edilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 Gün  | 1 Kg     | 200,00 TL/Numune      |
| CH-30                   | Filtrasyon (-147 mikron)                            | 147 mikron ve ince malzemeler filtre edilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 Gün  | 0,5 Kg   | 220,00 TL/Numune      |
| CH-31                   | Akım Şeması Belirleme                               | Tam teknolojik test akım şeması belirleme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 Gün  |          | 6.800,00<br>TL/Numune |
| <b>NUMUNE HAZIRLAMA</b> |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                       |
| NH1                     | Numune Hazırlama (Kayaç, Cevher , Toprak, Sediman)  | Numunelerde,<br>a) Kurutma (Etüv) (80°C'de),<br>b) Kırma (Çeneli Kırıcı ile %75'i -2mm),<br>c) Temsili Numune Alma ve<br>d) Öğütme (Öğütücü ile %85'i -75µm) işlemleri yapılır. Yaklaşık 250 gr numune hazırlanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 gün  | 0,5-2 Kg | 400 TL/Numune         |
| NH2                     | Yüksek Hassas Kesim (High Precision Cutting)        | Yüksek hassas kesim makinesi metaller, seramikler, elektronik bileşenler, kristaller, kompozitler, biyomalzemeler, sinterlenmiş karbürler, mineraller vb. gibi malzemelerin hassas ve deformasyonsuz kesimi için kullanılır. Kesme yüzeyleri hasar ve deformasyona uğramaz böylece kesilen numuneler kısa bir parlatma işleminden sonra mikroskop altında incelenebilir. Kesilebilen numune boyut aralığı: maksimum 75 mm çap, 50 mm en ve 175 mm uzunluğu boyutlarına sahip olan numuneler kesilebilir. Cihazın 60 mm'lik kesim kursu (kesme disk taşının numune uzunluğuna dik yönde hareket kursu) boyunca, numuneler birbirine paralel şekilde programlanabilir olarak seri kesim ve dilimler halinde dilimlendirilmesi yapılabilir. Tek işlemde otomatik olarak eşit veya farklı kalınlıklarda çok sayıda dilim alınabilir. Cihaz, birçok numune hazırlama uygulaması, farklı boyutlarda veya düzensiz şekilli parçaların cihazın uygun özel m mengeneleri ile tutturulup kesilerek onlardan numune çıkartılmasını sağlar. | 1 gün  | 0,5-2 Kg | 1000 TL/Numune        |
| NH3                     | Otomatik Montaj Presi<br>(Automatic Mounting Press) | Numune kesiminin ardından sonraki işlem kalıplamadır. Yüksek kapasiteli otomatik bakalite alma-kalıplama cihazı elektro-hidrolik çalışma prensibine dayalı olarak çalışır. Tamamen otomatiktir ve materyalografide kullanılan tüm güncel sıcak montaj malzemelerine uygundur. Küçük veya düzensiz şekilli numunelerin taşınmasını kolaylaştırır ve hazırlama işlemi sırasında hassas malzemeleri, ince katmanları veya kaplamaları korur. 25 mm'den 50 mm'ye kadar çeşitli çaptaki kalıpların kullanımı için uygun olup kalıp değiştirme işlemi kolay ve çabuktur. Tamamen elektrohidrolik basınç ve tahrik sistemi (hava gerekmez), 300 bar' a kadar kalıplama basıncı, 200°C' ye kadar sıcaklık ayarlama imkânı vardır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 gün  | 5-150 mg | 350 TL/Numune         |

|                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |                 |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| NH4            | Korozyon Numunesi Hazırlama | Şekli itibari ile düz plaka olarak gelen (maksimum 30 mm kalınlık) örnekler için ücret talep edilmesine gerek yoktur, ancak diğer şekillerde gelen numunelerin korozyon numunesi hazırlama gerektirir. Laboratuvarıda hücre diyaizni kalıp hazırlanması vb. işlemler yapılacaktır. Saat ücretlendirmesi yapılmakta olup, hizmet süresi, numune miktarı ve hizmet bedeli için lütfen cihaz sorumlusu ile iletişime geçiniz. | Değişken | Değişken        | 400 TL/ Saat    |
| NUMUNE SAKLAMA |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |                 |
| NS             | Numune Saklama              | Teknoloji çalışmalarına ait orijinal numune; çalışma raporlandıktan sonra 6 ay ücretsiz, 6 aydan sonra başvuru sahibinin talebi doğrultusunda en fazla 36 ay daha hizmet bedeli karşılığında saklanır.                                                                                                                                                                                                                     | 6-36 ay  | 0-50 Kg         | 200,00 TL/Kg/Ay |
|                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 50-100 Kg       | 180,00 TL/Kg/Ay |
|                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 100 Kg ve üzeri | 160,00 TL/Kg/Ay |

Tablo 16:

| FİZİKSEL VE KİMYASAL KARAKTERİZASYON BİRİMİ |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                         |                                             |                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANALİZ/TEST KODU                            | ANALİZ/TEST ADI                                                                               | ELEMENTLER                                                                                                                                                                                                                                                                               | METOT/AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                       | HİZMET SÜRESİ (İŞ GÜNÜ) | NUMUNE MİKTARI                              | HİZMET BEDELİ (KDV HARİÇ)                                                                         |
| LA-HR-ICP-MS İLE ESER ELEMENT ANALİZLERİ    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                         |                                             |                                                                                                   |
| ICP-MS1                                     | Sulu Numunelerde                                                                              | Cu (Bakır), Pb (Kurşun), Zn (Çinko), Mo (Molibden), Fe (Demir), Co (Kobalt), Cd (Kadmiyum), Ni (Nikel), As (Arsenik), Sb (Antimon), Se (Selenyum), Mn (Mangan)                                                                                                                           | SM 3125 B (ICP-MS Metodu) 0,1ppm'in altındaki değere sahip elementlerin analizi ICP-MS Cihazı ile yapılır. (0,1ppm'in üstündeki değere sahip elementlerin analizi ICP-OES Cihazı ile yapılır.)       | 10 gün                  | 250 ml                                      | Tümü 1200,00 TL veya bir element 400,00 TL ve sonraki her bir element 100,00 TL (Bir numune için) |
| ICP-MS2                                     | Nadir Toprak Elementleri Analizi (Toprak, Sediman, Cevher, Kayaç ve Kömür Külü Numunelerinde) | Ce (Seryum), Dy (Disprosiyum), Er (Erbiyum), Eu (Evropyum), Gd (Gadolinyum), Ho (Holmiyum), La (Lantan), Lu (Lutesyum), Nd (Neodimyum), Pr (Paraseodim), Sc (Skandiyum), Sm (Samaryum), Th (Toryum), Tm (Tulyum), Y (İtriyum), Yb (İterbiyum), Tb (Terbiyum), Hf (Hafniyum), U (Uranyum) | Üçlü asitte çözme işlemi veya Dörtlü asitte çözme işlemi ve ICP-MS Cihazı ile analiz                                                                                                                 | 10 gün                  | Öğütülmüş 5 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg   | Tümü 2000,00 TL veya bir element 800,00 TL ve sonraki her bir element 100,00 TL (Bir numune için) |
| ICP-MS3                                     | Kıymetli Metal Analizleri (Kayaç, Toprak ve Kum Numunelerinde)                                | Au (Altın), Ag (Gümüş), Pt (Platin), Pd (Paladyum), Ir (İridyum), Ru (Rutenyum), Rh (Rodyum)                                                                                                                                                                                             | Fire Assay Yöntemi+Kupelasyon Yöntemi+Asitte Çözme+ICP-MS Cihazı ile analiz                                                                                                                          | 7 gün                   | Öğütülmüş 150 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg | Tümü 1500,00 TL veya bir element 500,00 TL ve sonraki her bir element 200,00 TL (Bir numune için) |
| LA-HR-ICP-MS                                | Laser Ablation Direkt Katı Örnek Ölçümleri                                                    | Numuneler, araştırmacılar tarafından hazırlanacaktır ve SEM CL görüntüleri ile birlikte analize hazır olarak gönderilmelidir                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      | 10 gün                  | Öğütülmemiş 0,5 - 2 kg katı numune          | 3000,00 TL/Saat                                                                                   |
| ICP-OES                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                         |                                             |                                                                                                   |
| ICP-OES1                                    | Sulu Numunelerde                                                                              | *Cu (Bakır), *Pb (Kurşun), *Zn (Çinko), *Mo (Molibden), *Fe (Demir), *Co (Kobalt), *Cd (Kadmiyum), *Ni (Nikel), *As (Arsenik), *Sb (Antimon), *Se (Selenyum), *Mn (Mangan)                                                                                                               | SM 3120 B (ICP-OES Metodu) 0,1ppm'in üstündeki değere sahip elementlerin analizi ICP-OES Cihazı ile yapılır. (Not: 0,1ppm'in altındaki değere sahip elementlerin analizi ICP-MS Cihazı ile yapılır.) | 10 gün                  | 250 ml                                      | Tümü 1000,00 TL veya bir element 180,00 TL ve sonraki her bir element 100,00 TL                   |

|                       |                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                           |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ICP-OES2              | Toprak ve Kayaç Numunelerinde                     | *Cu (Bakır), *Pb (Kurşun), *Zn (Çinko), *Mo (Molibden), *Fe (Demir), *Co (Kobalt), *Cd (Kadmiyum), *Ni (Nikel), *As (Arsenik), *Sb (Antimon), *Se (Selenyum), *Mn (Mangan) | TS ISO 14869-1 Standardına göre çözme işlemi ve SM 3120 B Standardına göre ICP-OES Cihazı ile analiz                                                                                                                                                 | 10 gün | Öğütülmüş 5 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg | Tümü 1500,00 TL veya bir element 500,00 TL ve sonraki her bir element 100,00 TL                   |
| ICP-OES3              | Toprak, Sediman ve Kayaç Numunelerinde            | Rb (Rubidyum), Ba (Baryum), Cr (Krom), Sn (Kalay), Mn (Mangan), Sr (Stronsiyum), W (Volfram), Te (Tellür), Li (Lityum), B (Bor)                                            | TS ISO 14869-1 ve TS ISO 14869-2 Standartlarına göre çözme işlemi veya Alkali Eritiş Metodu ile çözme işlemi veya Dörtlü asitte çözme işlemi ve ICP-OES Cihazı ile analiz (Numunelerin matriksine göre alt ve üst dedeksiyon limitleri değişebilir.) | 10 gün | Öğütülmüş 5 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg | Tümü 1500,00 TL veya bir element 500,00 TL ve sonraki her bir element 100,00 TL                   |
| <b>WD-XRF ANALİZİ</b> |                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                           |                                                                                                   |
| WD-XRF-1              | Yarı Kantitatif Analiz                            | Metal oksitler+Ateş Zayıatı (Kızdırma Kaybı) Tayini                                                                                                                        | Yarı Kantitatif Analiz Numuneler Eritiş Yöntemiyle hazırlanmaktadır. Numunenin eritiş numune hazırlama prosedürümüze uygun olmadığı durumlarda, analizcinin uygun gördüğü başka bir analiz kodundan sonuçlar verilir.                                | 7 gün  | Öğütülmüş 5 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg | Tümü 1200,00 TL veya bir element 500,00 TL ve sonraki her bir element 100,00 TL (Bir numune için) |
| WD-XRF-2              | XRF Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama | Çalışmanın niteliğine göre belirlenir.                                                                                                                                     | Çalışmanın niteliğine göre belirlenir.                                                                                                                                                                                                               | 2 gün  |                                           | 1000,00 TL/Numune                                                                                 |
| <b>XRD ANALİZİ</b>    |                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                           |                                                                                                   |
| XRD1                  | XRD Analizi                                       | Rigaku miniflex600                                                                                                                                                         | Cu Kα radyasyonu kullanan Rigaku Miniflex 600 cihazı ile X ışını kırınımı analizi yapılır.                                                                                                                                                           | 5 gün  | Öğütülmüş 5 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg | 400,00 TL/Adet*                                                                                   |
| XRD2                  | XRD Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama | Çalışmanın niteliğine göre belirlenir.                                                                                                                                     | Çalışmanın niteliğine göre belirlenir.                                                                                                                                                                                                               | 2 gün  |                                           | 400,00 TL/Adet                                                                                    |

\*1 saati geçen analizlerde adetlik analiz ücretinin %50'si her bir saat başına analiz bedeline eklenir.

Tablo 17:

| KİMYASAL PROSES BİRİMİ |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                    |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ANALİZ/TEST KODU       | ANALİZ/TEST ADI                                                             | METOT/AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HİZMET SÜRESİ (İŞ GÜNÜ)                | NUMUNE MİKTARI                                     | HİZMET BEDELİ (KDV HARİÇ)                                             |
| TEST HİZMETLERİ        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                    |                                                                       |
| HBP1                   | Liç Deneyleri                                                               | 25-100 °C arası HCl, H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ve bazik ortam çözücülerle talebe göre çözeltiye alma işlemidir. Diğer asit çözücülerde işlemin yapılması halinde hizmet bedeli %50 artırımlı olarak uygulanır. Numune uygun boyutta değil ise uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin hizmet bedeli ayrıca ilave edilecektir.                                                                                                                                                                                                            | 2 gün                                  | En çok 500 g öğütülmüş numune                      | 1.500,00 TL/ Deney                                                    |
| HPB2                   | Biyoliç Deneyleri                                                           | Talebe göre demir ve/veya sülfür oksitleyici mezofilik, orta derecede termofilik veya termofilik bakteriler ile çözeltiye alma işlemidir. Diğer asit çözücülerde işlemin yapılması halinde hizmet bedeli %50 artırımlı olarak uygulanır. Numune uygun boyutta değil ise uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin hizmet bedeli ayrıca ilave edilecektir.                                                                                                                                                                                       | 30 gün                                 | En çok 500 g öğütülmüş numune                      | 3.500,00 TL/Deney                                                     |
| HPB3                   | Sıvı-Sıvı Özütleme (SX) Deneyleri                                           | Sıvı çözeltisi içindeki bileşenlerin zenginleştirilmesi veya ayrılması işlemidir. Deneylerde kullanılması talep edilen kimyasallar Analiz/Test Başvuru Formu'nda belirtilmeli ve numunelerle birlikte Numune Kabul Birimi'ne teslim edilmelidir. Katı numune getirilmesi durumunda numunenin durumuna göre uygun boyuta getirme işlemi (numune hazırlama) ile özütleme deney hizmet bedelleri ayrıca eklenecektir.                                                                                                                                    | 10 gün                                 | 3 litre yüklü çözelti veya en çok 1 kg katı numune | 3.000,00 TL/ Deney                                                    |
| HPB4                   | Kimyasal Çöktürme Deneyleri                                                 | Liç Deneyine uygulanan numunelere uygulanır. Özel çalışma talepleri Analiz/Test Başvuru Formu'nda belirtilmeli ve ihtiyaç duyulan kimyasal maddeler numunelerle birlikte Numune Kabul Birimi'ne teslim edilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 gün                                  | 2 litrelik yüklü çözelti                           | 750,00 TL/ Deney                                                      |
| HPB5                   | Tam Teknoloji Çalışmaları (Metalurjik/Hidrometalurjik /Biyohidrometalurjik) | Çalışmanın niteliğine göre; numune hazırlama, temsili numune alma, giriş analizleri, zenginleştirme deneyleri, sonuç analizleri, değerlendirme ve raporlandırma süreçlerini kapsayan metalurjik/hidrometalurjik araştırma çalışmalarıdır. Kurum dışı başvurularda sözleşme imzalanarak çalışmalara başlanır. Çalışma esnasında yapılacak analiz/testlerde %50 indirim uygulanacaktır. Ayrıca, çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulabilecek ve %20'ye kadar olabilecek analiz/test hizmet bedeli artışlarında, ilave hizmet bedeli talep edilmeyecektir. | Çalışmanın niteliğine göre belirlenir. | Çalışmanın niteliğine göre belirlenir.             | Çalışmanın niteliğine göre yapılan tüm analiz/testler ile belirlenir. |

## GENEL HİZMETLER

|      |                          |                                                                                                                                                                                                   |       |       |                  |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|
| GH1  | pH Tayini                | aSM 4500 H+B (Elektrometrik Metot)                                                                                                                                                                | 1 gün | 25 ml | 200,00 TL/Numune |
| GH2  | İletkenlik Tayini        | aSM 2510 B (Laboratuvar Metodu)                                                                                                                                                                   | 1 gün | 25 ml | 200,00 TL/Numune |
| GH3  | Azot Gaz Üretimi         | BERG marka PSA Azot Gazı Jeneratörü ile basınçlı havadan etkili nitrojen ayrımı için basınç salınımlı adsorpsiyonu (PSA) kullanan teknoloji ile yüksek saflıkta (%99,99) azot gazı sağlanmaktadır | 1 gün | Tüp   | 100,00 TL/Litre  |
| GH4  | Ultra Saf Su Kullanımı   |                                                                                                                                                                                                   |       |       | 18,00 TL/Litre   |
| GH5  | Vakum Etüv Kullanımı     |                                                                                                                                                                                                   |       |       | 180,00 TL/Gün    |
| GH6  | Etüv Kullanımı           |                                                                                                                                                                                                   |       |       | 135,00 TL/Gün    |
| GH7  | Kül Fırını Kullanımı     |                                                                                                                                                                                                   |       |       | 45,00 TL/Saat    |
| GH8  | Ultrasonik Su Banyosu    |                                                                                                                                                                                                   |       |       | 27,00 TL/ Saat   |
| GH9  | Soğutmalı Santrifüj      |                                                                                                                                                                                                   |       |       | 45,00 TL/Saat    |
| GH10 | Soğutmalı Mikrosantrifüj |                                                                                                                                                                                                   |       |       | 45,00 TL/Saat    |

**Tablo 18:**

| <b>MALZEME ÜRETİM BİRİMİ</b>                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>ANALİZ/TEST KODU</b>                                                                                                | <b>ANALİZ/TEST ADI</b>            | <b>METOT/AÇIKLAMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>HİZMET SÜRESİ (İŞ GÜNÜ)</b> | <b>HİZMET BEDELİ (KDV HARİÇ)</b> |
| <b>Çift Vidalı Ekstruder (Twin Screw Extruder)</b>                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                  |
| TSE                                                                                                                    | Ekstruder                         | Cihaz en fazla 300 °C'ye çıkmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 gün                          | 2000,00 TL/Saat                  |
| <b>Mikro Enjeksiyon Makinesi (Micro Injection Moulding Machine)</b>                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                  |
| MIMM                                                                                                                   | Mikro Enjeksiyon                  | Cihaz en fazla 300 °C'ye çıkmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 gün                          | 100,00 TL/Numune                 |
| <b>Spark Plazma Sinterleme Sistemi (Spark Plazma Sintering System)</b>                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                  |
| SPS                                                                                                                    | Spark Plazma Sinterleme           | Laboratuvar ölçekli üretim/metal ve alaşımlardan yapılan ürün ve malzemeler (2200°C'ye kadar)                                                                                                                                                                                                                                        | 1 gün                          | 3500,00 TL/Numune                |
| <b>Yüksek Sıcaklık-Yüksek Vakum Fırını</b>                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                  |
| YSF                                                                                                                    | Yüksek Sıcaklık-Yüksek Vakum      | Laboratuvar ölçekli üretim/metal ve alaşımlardan yapılan ürün ve malzemeler (2200°C'ye kadar)                                                                                                                                                                                                                                        | 1 gün                          | 2000,00 TL/Numune                |
| <b>Vakum Ark Ergitme Sistemi (Vacuum Arc Melting System)</b>                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                  |
| VAM                                                                                                                    | Vakum Ark Ergitme                 | Laboratuvar ölçekli üretim/metal ve alaşımlardan yapılan ürün ve malzemeler                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 gün                          | 4000,00 TL/Numune                |
| <b>Eriyik Eğirme Sistemi (Melt Spinning System)</b>                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                  |
| MS                                                                                                                     | Eriyik Eğirme                     | Laboratuvar ölçekli üretim/metal ve alaşımlardan yapılan ürün ve malzemeler (Bor nitrür eritme potası araştırmacı tarafından temin edilecektir)                                                                                                                                                                                      | 1 gün                          | 6000,00 TL/Numune                |
| <b>3D Yazıcı (3D Printer)</b>                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                  |
| 3D                                                                                                                     | 3D printer                        | Laboratuvar ölçekli üretim- polimer esaslı malzeme üretimi                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 gün                          | 10,00 TL/Gram                    |
| <b>Glovebox Kombineli Fiziksel Buhar Biriktirme Sistemi (Physical Vapour Deposition System Combined with Glovebox)</b> |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                  |
|                                                                                                                        | Fiziksel Buhar Biriktirme Sistemi | <p>Sistem, oksijen ve nem değerleri 1 ppm altında olacak şekilde glovebox içerisinde 2 adet Termal Buharlaştırma, 1 adet DC ve 1 adet RF Saçırma ile kaplama işlemi gerçekleştirmektedir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Her bir işlem için aynı anda en fazla 2x2 cm<sup>2</sup>'lik 5 adet numune kaplanır.</li> </ul> | 1-2 gün                        | 2500,00 TL/Kaplama               |

|                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| GB-PVD                                                                   |                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaplama için gerekli sarf malzeme arařtırmacı tarafından temin edilir.</li> <li>Termal buharlařtırma için tungsten pota veya kayık gereklidir</li> <li>Saętırma/sputter hedefler 2 inch ap'ta olması gerekir.</li> </ul> <p>Kaplama iřleminde kaplanacak malzemelerin yüzeyi pürüzsüz/parlatılmış ve temiz olmalıdır.</p>                                    |         |                 |
| <b>Soğuk İzostatik Presleme Sistemi (Cold Isostatic Pressing System)</b> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                 |
| CIP                                                                      | Soğuk İzostatik Pres                    | <p>CIP ile malzemelerin preslenmesi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimum 300 MPa basın uygulanır.</li> <li>Maksimum presleme ebadı 100x300 mm'dir.</li> </ul> <p>İstenen boyut veya ebat için gerekli kauuk veya poliüretan kalıp arařtırmacı tarafından temin edilir.</p>                                                                                                          | 1 gün   | 1000,00 TL/Saat |
| <b>Akışkan Yataklı Değirmen (Bet Jet Mill)</b>                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                 |
| BJM                                                                      | Akışkan yataklı değirmen (Bet jet mill) | Öğütme ekipmanı Netzsch Lab Pilot ile ince öğütücüleri ve ultra ince sınıflandırıcıları en yüksek düzeyde inceliğı ve optimum verimliliğı temsil eder. Uygun laboratuvar makineleriyle kanıtlanmış teknoloji, yeni ürünlerin geliştirilmesinde ve hatta laboratuvar öleğinde küçük miktarlarda üretim için de kullanılabilir.                                                                       | 1 gün   | 3000,00 TL/Saat |
| <b>Bilyeli Değirmen</b>                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                 |
| BD                                                                       | Gezegen tipi bilyeli değirmen           | Öğütme ve alařımlama ekipmanı (Fritsch Pulverisette 5/2) iki alışma istasyonuyla, öğütme bilyelerinin özellikle yüksek enerji etkisi nedeniyle, kolloidal inceliğe kadar sert, orta sert, yumuşak, kırılğan, sert malzemelerin kayıpsız öğütme sonuçlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde sunar. 400 rpm'ye kadar dönüş hızlarıyla hızlı öğütme ve 1  m'nin altında son incelik sağlanabilmektedir. | 1-5 gün | 200,00 TL/Saat  |

Tablo 19:

| MALZEME KARAKTERİZASYON BİRİMİ |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ANALİZ/TEST KODU               | ANALİZ/TEST ADI                                                       | METOT/AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HİZMET SÜRESİ (İŞ GÜNÜ)                                                                                                                                                                                                                                                                  | NUMUNE MİKTARI                                                                                                  | HİZMET BEDELİ (KDV HARİÇ) |
| FIB-SEM                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                           |
| FIBSEM-1                       | FE-SEM yüksek çözünürlüklü görüntüleme (ETD, T1/T2D, BSE, DBS, LVD)   | Fotoğraflar ve EDS analiz sonuçları CD ortamına kaydedilir. Numune hazırlama hizmet bedeli her bir numune için ayrıca eklenecektir. Hazır gelen numunelerden Numune Hazırlama hizmet bedeli alınmayacaktır.                                                                                                       | Analiz başvurusu yapılmadan önce Numune Kabul Birimi aracılığı ile ilgili Birimle irtibata geçilmesi ve randevu alınması gerekmektedir. Başvurunun kabul edilmesine müteakip yapılan termin planına göre analizin tamamlanma süresi belirlenir ve süre ile ilgili bilgilendirme yapılır. | En az 1x1x1 cm, en fazla 2x2x2 cm ebatlarında veya toz numune<br><br>1 saat içinde 3 numune analiz edilmektedir | 1000,00 TL/Saat           |
| FIBSEM-2                       | FIB+SEM yüksek çözünürlüklü görüntüleme                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Çalışmanın niteliğine göre belirlenir.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 saat içinde 2 numune analiz edilmektedir                                                                      | 2500,00 TL/Saat           |
| FIBSEM-3                       | FIB-SEM 3D Analizi (Lif, Gözeneklilik, Geçirgenlik, Tane ve Parçacık) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 saat içinde 3 numune analiz edilmektedir                                                                      | 1800,00 TL/Saat           |
| FIBSEM-4                       | FE-SEM/EDS Noktasal Analiz ve Haritalama                              | Enerji dağılımlı X-ışınları ile B atomundan öncekiler hariç tüm elementler analiz edilir. Yüksek vakum koşulları altında numune yüzeyinden ikincil elektron (SE), geri saçılmış elektron (BSE) veya karışık (SE+BSE) sinyal görüntüleri alınarak fotoğraf çekilir ve CD ortamına JPEG dosya formatında kaydedilir |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 saat içinde 3 numune analiz edilmektedir                                                                      | 2000,00 TL/Saat           |
| FIBSEM-5                       | EBSD Nokta Analizi ve Haritalama                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 saat içinde 1 numune analiz edilmektedir                                                                      | 2500,00 TL/Saat           |
| FIBSEM-6                       | FE-SEM- Katodoluminesans (SEM-CL)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 saat içinde 3 numune analiz edilmektedir                                                                      | 2000,00 TL/Saat           |
| FIBSEM-7                       | STEM Numune Hazırlama                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 saat içinde 1 numune analiz edilmektedir                                                                      | 4000,00 TL/Adet           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIBSEM-8                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MLA (Mineral Serbestleşme Analizi)            | Sadece teknoloji çalışması yapılan tane ve ince film numunelerine uygulanan analizdir. Analiz sonucunda her bir numuneye ait kantitatif modal mineralojik bileşim, hesaplanmış element içeriği, elementsel dağılım, parçacık boyut dağılımı, mineral boyut dağılımı, mineral birliktelikleri, serbestleşme derecesi, kenetlenme durumu, parçacık yoğunluğu ve parçacık şekil parametrelerini kapsayan veri tabanı dosyası CD ortamına kaydedilerek teslim edilir. Numunenin mineralojik bileşiminin, cevher içeriğinin, tane boyunun, elek fraksiyonlarının ve yapılacak olan MLA analizinin belirlenebilmesi için bir ön çalışma yapılması gerekmektedir. Analiz/Test Başvuru Formu ile tek seferde en fazla 4 (sekiz) adet numune kabul edilmektedir. | Analiz başvurusu yapılmadan önce Numune Kabul Birimi aracılığı ile ilgili Birimle irtibata geçilmesi ve randevu alınması gerekmektedir.          | Öğütülerek farklı elek fraksiyonlarına ayrılmış en az 10, en fazla 100 g cevher numunesi<br><br>1 saat içinde 1 numune analiz edilmektedir | 15000,00 TL/Adet                                                                                             |
| FIBSEM-9                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Başvurunun kabul edilmesine müteakip yapılan termin planına göre analizin tamamlanma süresi belirlenir ve süre ile ilgili bilgilendirme yapılır. |                                                                                                                                            | 2500,00 TL/Adet                                                                                              |
| <b>SEM-EDS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| SEM1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SEM Kaplama                                   | Au Kaplama Cihazı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 gün                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 300,00 TL/Set*                                                                                               |
| SEM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SEM+EDS Noktasal/Haritalama**                 | 1 saat altı ölçümler için (Hitachi SU3500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 gün                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 500,00 TL/Saat                                                                                               |
| SEM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SEM+EDS Noktasal/Haritalama                   | 1 saat ve üzeri ölçümler için (Saatte en fazla 4 numune) (Hitachi SU3500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 gün                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 850,00 TL/Saat***                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>*1 set, 4 adet numuneden oluşmaktadır.</li> <li>** Her bir numune için ikiden fazla EDS spektrumu alınması durumunda, spektrum başına 250 TL ek ücret eklenir.</li> <li>***1 saati geçen analizlerde saat başı analiz bedeline eklenecek tutardır.</li> </ul> |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| <b>UV-VIS-NIR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| UV1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Spektrum Tarama                               | Bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek yüzeyinden yansıtıldıktan sonraki azalması ölçülür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 gün                                                                                                                                            | Örnek çözeltisi berrak ve kör ölçümleri için yeterli miktarda çözücü olmalıdır.                                                            | 400,00 TL/Numune                                                                                             |
| <b>DMA (DİNAMİK MEKANİK ANALİZ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| DMA (25°C - 600°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dinamik Mekanik Analiz                        | Cihaz -150 ve 600 °C arasında çalışmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 gün                                                                                                                                            | Çalışmanın niteliğine göre belirlenir.                                                                                                     | 1 saat: 300,00 TL/numune<br>2 saat: 450,00 TL/numune<br>3 saat: 550,00 TL/numune<br>4 saat: 625,00 TL/numune |

|                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                           |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMA (-150°C - 600°C)                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                           | 1 saat: 600,00 TL/numune<br>2 saat: 750,00 TL/numune<br>3 saat: 950,00 TL/numune<br>4 saat: 1050,00 TL/numune      |
| <b>DSC (DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE)</b>                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                           |                                                                                                                    |
| DSC1                                                            | Diferansiyel termal karakterizasyon            | Cihaz en fazla 1400 °C'ye çıkmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 gün                                  | 0,5 gr katı-toz numune                    | 1 saat: 1000,00 TL/numune<br>2 saat: 1225,00 TL/numune<br>3 saat: 1800,00 TL/numune<br>4-6 saat: 2025,00 TL/numune |
| <b>PARÇACIK BOYUT ZETA POTANSİYEL ANALİZİ</b>                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                           |                                                                                                                    |
| PSZP1                                                           | Parçacık Boyut Analizi                         | Taneler arasındaki itme-çekme değeri belirlenerek flotasyon v.b. işlemlerde tanelerin davranışları incelenir. Tane boyutu -10 µm (mikron) olmalıdır. Numune uygun boyutta değil ise, uygun boyuta (-10 µm) getirilmesi için uygulanan işlemin hizmet bedeli ve süresi ayrıca ilave edilecektir. | 2 gün                                  | -10µ tane boyutunda 100 - 500 g           | 500,00 TL/Numune                                                                                                   |
| PSZP2                                                           | Zeta Potansiyeli Ölçümü                        | Taneler arasındaki itme-çekme değeri belirlenerek flotasyon v.b. işlemlerde tanelerin davranışları incelenir. Tane boyutu -10 µm (mikron) olmalıdır. Numune uygun boyutta değil ise, uygun boyuta (-10 µm) getirilmesi için uygulanan işlemin hizmet bedeli ve süresi ayrıca ilave edilecektir. | 2 gün                                  | -10µ tane boyutunda 100 - 500 g           | 500,00 TL/Numune                                                                                                   |
| PSZP5                                                           | Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama  | Çalışmanın niteliğine göre belirlenir.                                                                                                                                                                                                                                                          | Çalışmanın niteliğine göre belirlenir. | Çalışmanın niteliğine göre belirlenir.    | 2000,00 TL/Numune                                                                                                  |
| <b>TERMOGRAVİMETRİK VE DİFERANSİYEL TERMAL ANALİZ (TGA-DTA)</b> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                           |                                                                                                                    |
| TGA-DTA                                                         | Termogravimetrik ve Diferansiyel Termal Analiz | DTG 60 ile termal analiz                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 gün                                  | Öğütülmüş 5 g veya öğütülmemiş 0,5 - 2 kg | 0-1 saat: 400 TL/numune<br>1-3 saat: 500 TL/numune                                                                 |
| <b>X-IŞINI FOTOELEKTRON SPEKTROSKOPİ (XPS)</b>                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                           |                                                                                                                    |
| XPS-1                                                           | Genel Tarama (Nokta Analiz)                    | X-ışın demeti kullanarak fotoelektronların saçılmasını sağlayıp kimyasal bağlarını ölçme                                                                                                                                                                                                        | 3 gün                                  |                                           | 1000,00 TL/Adet                                                                                                    |

|                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| XPS-2                                                                       | Kısmi Tarama (Nokta Analiz)                                 | Sekiz Elemente kadar                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 gün |                                                               | 2400,00 TL/Adet  |
| XPS-3                                                                       | Haritalama                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 gün |                                                               | 2400,00 TL/Saat  |
| XPS-4                                                                       | Derinlik Profili                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 gün |                                                               | 2400,00 TL/Saat  |
| XPS-5                                                                       | Özel Analiz                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 gün |                                                               | 4000,00 TL/Adet  |
| XPS-6                                                                       | Yorumlama ve Raporlama                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 gün |                                                               | 4500,00 TL/Adet  |
| <b>TİTREŞİMLİ NUMUNE MANYETOMETRESİ (VSM-VIBRATING SAMPLE MAGNETOMETER)</b> |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                               |                  |
| VSM-1                                                                       | DC Direncin Sıcaklıkla değişimi ( $\rho$ -T)                | 4 nokta ölçüm (Manyetik Malzemeler)                                                                                                                                                                                                                                        | 2 gün | Numune boyutu en fazla 5mm x 2mmx 2mm boyutlarında olmalıdır. | 1200,00 TL/Adet  |
| VSM-2                                                                       | Sıcaklığa bağlı DC manyetizasyon (M-T)                      | Sabit manyetik alan titreşimli örnek magnetometresi (Manyetik Malzemeler)                                                                                                                                                                                                  | 2 gün | Numune boyutu en fazla 5mm x 2mmx 2mm boyutlarında olmalıdır. | 1500,00 TL/Adet  |
| VSM-3                                                                       | Manyetik alana bağlı DC manyetizasyon (M-H)                 | Sabit sıcaklık titreşimli örnek magnetometresi (Manyetik Malzemeler)                                                                                                                                                                                                       | 2 gün | Numune boyutu en fazla 5mm x 2mmx 2mm boyutlarında olmalıdır. | 1800,00 TL/Adet  |
| <b>ERİYİK AKIŞ İNDEKSİ (MFI-MELT FLOW INDEX)</b>                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                               |                  |
| MFI-1                                                                       | Eriyik Akış İndeksi                                         | Cihaz oda sıcaklığı ve 400 °C arasında çalışmaktadır.                                                                                                                                                                                                                      | 1 gün | Çalışmanın niteliğine göre belirlenir.                        | 200,00 TL/Numune |
| <b>SOLAR SİMÜLATÖR SİSTEM</b>                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                               |                  |
| SSS-1                                                                       | Güneş Pili Karakterizasyonu                                 | Farklı ışık şiddetlerinde Akım-Voltaj, Güç-Voltaj, Empedans ve diğer fotovoltaik parametre ölçümlerini kapsar. Numunelerin ölçümü için gerekli kontakların yapılması gerekmektedir. Numune boyutları maksimum 2x2 cm <sup>2</sup> ebatlarında olmasına dikkat edilmelidir. | 2 gün |                                                               | 2500,00 TL/Adet  |
| SSS-2                                                                       | Yarı-iletken temelli elektronik aygıtların Karakterizasyonu | Tek veya Farklı ışık şiddetlerine bağlı olarak C-V, C-f, C-t, Cadj-V, Gadj-V, Dit-frequency ölçümlerini kapsar. Numunelerin ölçümü için gerekli kontaklar yapılması gerekmektedir. Numune boyutları maksimum 2x2 cm <sup>2</sup> ebatlarında olmasına dikkat edilmelidir.  | 2 gün |                                                               | 2500,00 TL/Adet  |

### 3D OPTİK PROFİLER İLE YÜZEY ANALİZİ

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                              |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------|
| 3D1 | Yüzey topografyası ve pürüzlülük ölçümü                           | Müşterinin iletişime geçerek bilgi alması gereklidir. Optik başına tek alan taraması ve pürüzlük ölçümünü içermektedir. Renkli yüzey topografyası analizi yapılmakta ve yüzey pürüzlülük analizi sunulmakta olup 10X optik için 0.88 um çözünürlükte taranacak alan 2mm x 1.7mm, 20X optik için 0.44 um çözünürlükte taranacak alan 1mm x 0.85mm, 50X optik için 0.176 um çözünürlükte taranacak alan 0,4mm x 0.34mm, 100X optik için 0.088 um çözünürlükte taranacak alan 0.2mm x 0.17mm değerlerine optimum örnekler için ulaşılabilir. Gönderilen yüzeyin düz olması data kalitesi açısından önem arz etmektedir. | 1-3 gün | Numune başına en fazla 3 ölçüm alınmaktadır. | 600,00 TL/Numune |
| 3D2 | Büyük yüzey stitching/dikiş şeklinde resim birleştirme ile analiz | Müşterinin iletişime geçerek bilgi alması gereklidir. İncelenecek yüzey alanın büyük olduğu (örneğin 4 cm <sup>2</sup> ) gibi tarama kareleri 0.1 nm hassasiyetle taranarak birleştirme işlemi yapılmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-3 gün |                                              | 1500,00 TL/Saat  |

### KATI CİSİM EMPEDANS VE DİELEKTRİK SABİTİ ÖLÇÜMÜ

|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |                  |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------|
| IM1 | Katı Cisim Oda Sıcaklığı Empedans Ölçümü     | Bu analizde katı cisimler 35 MHz frekans değerine kadar analiz edilmektedir. Dairesel örneklerin hazırlanması gerekli olup örnek çapı 12 mm'den fazla olmamalıdır, örnek kalınlığı tercihen birkaç mm'den fazla olmamalıdır, Örnek türü katı film ve seramik olmak üzere oldukça geniş bir malzeme türü listesini kapsamaktadır. Ürünün ham datası Excel formatında sunulacaktır.                                                                                                                                                                            | 2 gün |  | 600,00 TL/Numune |
| IM2 | Katı Cisim Değişken Sıcaklık Empedans Ölçümü | 5°C artışlar ile 1200°C değerine kadar analiz edilmektedir. Gönderilen malzemenin hangi sıcakta viskoz olduğu analiz sıcaklığı belirlenmeden önce belirlenmiş olmalıdır. Bu analiz ile katı cisimler 35 MHz frekans değerine kadar analiz edilmektedir. Dairesel örneklerin hazırlanması gerekli olup örnek çapı 12 mm'den fazla olmamalıdır, örnek kalınlığı tercihen birkaç mm'den fazla olmamalıdır, Örnek türü katı film ve seramik olmak üzere oldukça geniş bir malzeme türü listesini kapsamaktadır. Ürünün ham datası excel formatında sunulacaktır. | 2 gün |  | 1000,00 TL/Saat  |

|                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-------------------|
| IM3                              | Raporlama                                                                                                                                             | En fazla 4 grafik olmak üzere Uygulanan Empedans Değerine Karşı Dielektrik Değişimi, Faz Kayması, BODE plot gibi veriler sunulacaktır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 gün   |  | 3500,00 TL/Numune |
| <b>ELEKTROKİMYASAL ANALİZLER</b> |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |                   |
| EC1                              | Kuvartz kristal mikroterazi elektrokimyasal tekniği ile elektoraktif türlerin molekül ağırlığı ile tespiti                                            | Bu analizden önce müşterinin önden iletişime geçmesi önem arz etmektedir. Analiz sırasında müşteri tarafından sağlanan kristaller kullanılması gerekmekte ya da kristal içinde ödeme yapılması gerekmektedir. Müşteri Altın veya Platin yüzeylerden hangisini seçtiğini belirtmelidir. Analiz 10 MHz frekans değerine ve 0.276 cm <sup>2</sup> elektroaktif yüzey alanına sahip AT kesim kuvartz üzerine kaplanmış elektroaktif metal yüzey üzerinde gerçekleştirilecektir. 4.4 ng/(cm <sup>2</sup> ·Hz) hassasiyet tespiti ile ölçüm alınabilmekte, organik, inorganik ve biyolojik DNA/hücre analizleri gerçekleştirilebilmektedir.                                         | 1-5 gün |  | 1500,00 TL/Numune |
| EC2                              | Glove Box içinde inert azot gazı ortamında Kuvartz kristal mikroterazi elektrokimyasal tekniği ile elektoraktif türlerin molekül ağırlığı ile tespiti | Bu analizden önce müşterinin önden iletişime geçmesi önem arz etmektedir. Analiz sırasında müşteri tarafından sağlanan kristaller kullanılması gerekmekte ya da kristal içinde ödeme yapılması gerekmektedir. Müşteri Altın veya Platin yüzeylerden hangisini seçtiğini belirtmelidir. Analiz 10 MHz frekans değerine ve 0.276 cm <sup>2</sup> elektroaktif yüzey alanına sahip AT kesim kuvartz üzerine kaplanmış Au veya Pt üzerinde gerçekleştirilecektir. 4.4 ng/(cm <sup>2</sup> ·Hz) hassasiyet tespiti ile ölçüm alınabilmekte, organik, inorganik ve biyolojik DNA/hücre analizleri gerçekleştirilebilmektedir.                                                       | 1-5 gün |  | 1800,00 TL/Numune |
| EC3                              | Kuvartz kristal mikroterazi elektrokimyasal tekniği deney esnasında eş zamanlı verim analizi                                                          | Bu analizden önce müşterinin önden iletişime geçmesi önem arz etmektedir. Analiz sırasında müşteri tarafından sağlanan kristaller kullanılması gerekmekte yada kristal içinde ödeme yapılması gerekmektedir. Müşteri Altın veya Platin yüzeylerden hangisini seçtiğini belirtmelidir. Analiz 10 MHz frekans değerine ve 0.276 cm <sup>2</sup> elektroaktif yüzey alanına sahip AT kesim kuvartz üzerine kaplanmış Au veya Pt üzerinde gerçekleştirilecektir. 4.4 ng/(cm <sup>2</sup> ·Hz) hassasiyet tespiti ile ölçüm alınabilmekte, elektrokimyasal oksidasyon veya redüksiyon proseslerine bağlı birim akım başına kütle artışı veya azalışı ile verim tayini yapılabilir. | 1-5 gün |  | 1500,00 TL/Numune |

|     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|
| EC4 | Glove Box içinde inert azot gazı ortamında Kuvartz kristal mikroterazi elektrokimyasal tekniği deney esnasında eş zamanlı verim analizi | Bu analizden önce müşterinin önden iletişime geçmesi önem arz etmektedir. Analiz sırasında müşteri tarafından sağlanan kristaller kullanılması gerekmektedir. Müşteri Altın veya Platin yüzeylerden hangisini seçtiğini belirtmelidir. Analiz 10 MHz frekans değerine ve 0.276 cm <sup>2</sup> elektroaktif yüzey alanına sahip AT kesim kuvartz üzerine kaplanmış Au veya Pt üzerinde gerçekleştirilecektir. 4.4 ng/(cm <sup>2</sup> ·Hz) hassasiyet tespiti ile ölçüm alınabilmekte, elektrokimyasal oksidasyon veya redüksiyon proseslerine bağlı birim akım başına kütle artışı veya azalışı ile verim tayini yapılabilmektedir. | 1-5 gün |          | 1800,00 TL/Numune |
| EC5 | Kuvartz kristal mikroterazi kristal bedeli                                                                                              | Au veya Pt kristal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-5 gün |          | 2000,00 TL        |
| EC6 | Glove Box içinde inert azot gazı ortamında Katı Faz Batarya ve Kapasitör Şarj/Deşarj Analizi                                            | Bu analizden önce müşterinin önden iletişime geçmesi önem arz etmektedir. Kullanılan batarya voltaj aralığı şarj ve deşarj durumlarında uygulanacak akım geçişi türüne göre deney süresi önemli ölçüde değişeceğinden uygulanan fiyatlama değişecektir. Ürünün ham datası Excel formatında sunulacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-5 gün | 1 numune | 1000,00 TL/Saat   |
| EC7 | Açık atmosfer şartlarında Katı Faz Batarya ve Kapasitör Şarj/Deşarj Analizi                                                             | Bu analizden önce müşterinin önden iletişime geçmesi önem arz etmektedir. Kullanılan batarya voltaj aralığı şarj ve deşarj durumlarında uygulanacak akım geçişi türüne göre deney süresi önemli ölçüde değişeceğinden uygulanan fiyatlama değişecektir. Ürünün ham datası Excel formatında sunulacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-5 gün |          | 1000 TL/Saat      |
| EC8 | Açık atmosfer Kronoamperometri, Kronopotansiyometri ve Kronokulometri Analizleri                                                        | Bu analizden önce müşterinin önden iletişime geçmesi önem arz etmektedir. Kronoamperometride akım, kronokülometride ise yük, potansiyel bir adım pertürbasyonunun uygulanmasından sonra zamanın bir fonksiyonu olarak ölçülür. Kronopotansiyometri durumunda bir akım adımı uygulanır ve potansiyelin zamana bağlı değişimi tespit edilir. Bu teknikler gerek bir türün dedeksiyon limitinin ölçülmesi için geliştirilmiş sensör elektrotlar için gerekse çekirdeklenme matematiksel modellerinin incelenmesi için uygulanabilmektedir. Ürünün ham datası Excel formatında sunulacaktır.                                             | 1-5 gün |          | 1500,00 TL/Saat   |

|      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |  |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------------|
| EC9  | Glove Box içinde inert azot gazı ortamında Kronoamperometri, Kronopotansiyometri ve Kronokulometri Analizleri | Bu analizden önce müşterinin önden iletişime geçmesi önem arz etmektedir. Kronoamperometre de akım, kronokülometride ise yük, potansiyel bir adım pertürbasyonunun uygulanmasından sonra zamanın bir fonksiyonu olarak ölçülür. Kronopotansiyometri durumunda bir akım adımı uygulanır ve potansiyelin zamana bağlı değişimi tespit edilir. Bu teknikler gerek bir türün dedeksiyon limitinin ölçülmesi için geliştirilmiş sensör elektrotlar için gerekse çekirdeklenme matematiksel modellerinin incelenmesi için uygulanabilmektedir. Ürünün ham datası Excel formatında sunulacaktır. | 1-5 gün |  | 1800,00 TL/Saat |
| EC10 | Açık atmosfer şartlarında TAFEL korozyon testi                                                                | Bu analizden önce müşterinin önden iletişime geçmesi önem arz etmektedir. Referans elektrot türü korozyon ortamı gibi şartlar önceden belirtilmelidir. 2 mm <sup>2</sup> yüzey alanından 10 mm dairesel çap a sahip yüzey alanına kadar parlatılmış düz numunelerin 0.166 mV/s tarama hızı ile TAFEL testleri gerçekleştirilmektedir. Tarama hızı müşterinin ihtiyacına ve/veya yüzey denge şartlarının bozunma hızına göre belirli ölçülerde arttırılabilir veya azaltılabilir. Ürünün ham datası Excel formatında sunulacaktır.                                                         | 1-5 gün |  | 1000,00 TL/Saat |
| EC11 | Glove Box içinde inert azot gazı ortamında TAFEL korozyon testi                                               | Bu analizden önce müşterinin önden iletişime geçmesi önem arz etmektedir. Referans elektrot türü korozyon ortamı gibi şartlar önceden belirtilmelidir. 2 mm <sup>2</sup> yüzey alanından 10 mm dairesel çap a sahip yüzey alanına kadar parlatılmış düz numunelerin 0.166 mV.s-1 tarama hızı ile TAFEL testleri gerçekleştirilmektedir. Tarama hızı müşterinin ihtiyacına ve/veya yüzey denge şartlarının bozunma hızına göre belirli ölçülerde arttırılabilir veya azaltılabilir. Ürünün ham datası Excel formatında sunulacaktır.                                                       | 1-5 gün |  | 1800,00 TL/Saat |
| EC12 | Elektrokimyasal deneyler için numuneden elektrot hazırlama                                                    | Bu işlemde çalışma elektrotu olarak görev alacak parça gerek 3D den bastırılmış kalıplara epoksi ile gömülerek, gerek pürüzlü ise parlatılma işlemi yapılarak hazırlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-5 gün |  | 600,00 TL/ Saat |
| EC13 | Açık atmosfer şartlarında elektrokimyasal empedans spektroskopisi analizi                                     | Bu analizden önce müşterinin önden iletişime geçmesi önem arz etmektedir. Müşterinin numune ölçüleri ve Faraday kafesi talepleri incelenecektir. Testler 5 MHz üst limit değerine kadar sıvı ortamında 5 elektrot sistemi ile gerçekleştirilecektir. Ürünün ham datası Excel formatında sunulacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-5 gün |  | 1500,00 TL/Saat |

|      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |  |                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-------------------|
| EC14 | Glove Box içinde inert azot gazı elektrokimyasal empedans spektroskopisi analizi | Bu analizden önce müşterinin önden iletişime geçmesi önem arz etmektedir. Müşterinin numune ölçüleri ve Faraday kafesi talepleri incelenecektir. Testler 5 MHz üst limit değerine kadar sıvı ortamında 5 elektrot sistemi ile gerçekleştirilecektir. Ürünün ham datası Excel formatında sunulacaktır. | 1-5 gün |  | 2500,00 TL/Saat   |
| EC15 | Raporlama                                                                        | İlişkili grafikler hazırlanarak özetlenecektir                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-5 gün |  | 1800,00 TL/Numune |



Bu proje Avrupa Birliđi ve Trkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.



# NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (NTE) PROJESİ

## MUNZUR NİVERSİTESİ


### NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ UYGULAMA VE

### ARAŞTIRMA MERKEZİ (MUNTEAM)

### LABORATUVARLARI VE EKİPMANLARI





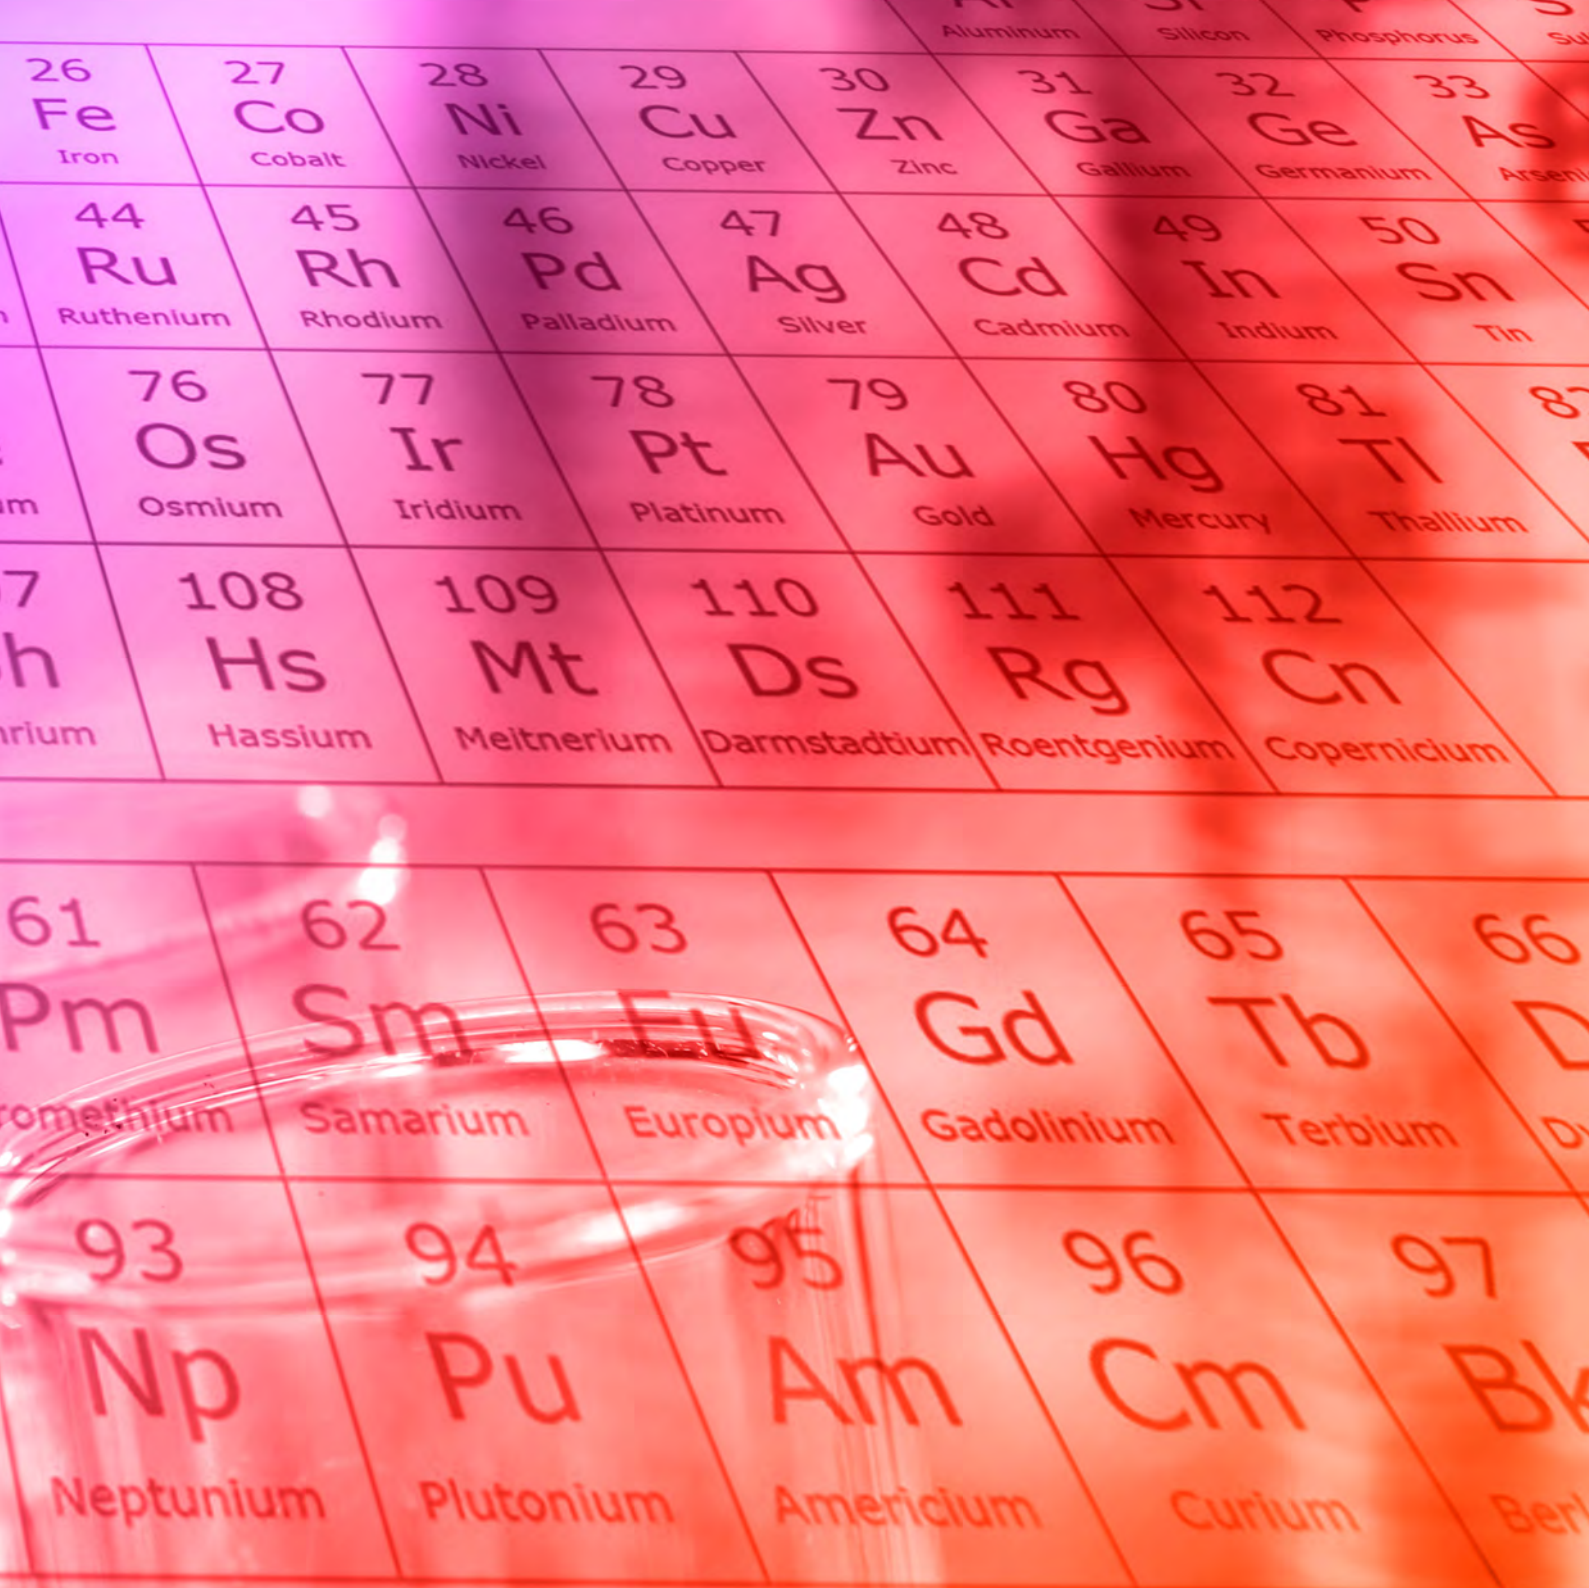

|                       |                      |                         |                           |                          |                          |                       |                        |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 26<br>Fe<br>Iron      | 27<br>Co<br>Cobalt   | 28<br>Ni<br>Nickel      | 29<br>Cu<br>Copper        | 30<br>Zn<br>Zinc         | 31<br>Ga<br>Gallium      | 32<br>Ge<br>Germanium | 33<br>As<br>Arsenic    |
| 44<br>Ru<br>Ruthenium | 45<br>Rh<br>Rhodium  | 46<br>Pd<br>Palladium   | 47<br>Ag<br>Silver        | 48<br>Cd<br>Cadmium      | 49<br>In<br>Indium       | 50<br>Sn<br>Tin       | 51<br>Sb<br>Antimony   |
| 76<br>Os<br>Osmium    | 77<br>Ir<br>Iridium  | 78<br>Pt<br>Platinum    | 79<br>Au<br>Gold          | 80<br>Hg<br>Mercury      | 81<br>Tl<br>Thallium     | 82<br>Pb<br>Lead      | 83<br>Bi<br>Bismuth    |
| 107<br>Bh<br>Bohrium  | 108<br>Hs<br>Hassium | 109<br>Mt<br>Meitnerium | 110<br>Ds<br>Darmstadtium | 111<br>Rg<br>Roentgenium | 112<br>Cn<br>Copernicium | 113<br>Nh<br>Nihonium | 114<br>Fl<br>Flerovium |

|                        |                       |                       |                        |                       |                         |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 61<br>Pm<br>Promethium | 62<br>Sm<br>Samarium  | 63<br>Eu<br>Europium  | 64<br>Gd<br>Gadolinium | 65<br>Tb<br>Terbium   | 66<br>Dy<br>Dysprosium  |
| 93<br>Np<br>Neptunium  | 94<br>Pu<br>Plutonium | 95<br>Am<br>Americium | 96<br>Cm<br>Curium     | 97<br>Bk<br>Berkelium | 98<br>Cf<br>Californium |



# İÇİNDEKİLER

4

## Nadir Toprak Elementleri (NTE) Projesi Hakkında

Projenin Nihai Faydalanıcısı

Proje Ortakları

NTE Projesi'nin Amacı

5

## Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Arastırma Merkezi (MUNTEAM)

MUNTEAM'ın Ar-Ge Alanları Nelerdir?

MUNTEAM Olarak Misyonumuz

MUNTEAM Olarak Vizyonumuz

8

## MUNTEAM Organizasyon Şeması

10

## Birimlerimiz ve Hizmetlerimiz

Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme

Fiziksel Ve Kimyasal Karakterizasyon

Kimyasal Proses Birimi

Malzeme Üretim Ve Karakterizasyon

Malzeme Üretim

Malzeme Karakterizasyon

# Nadir Toprak Elementleri (NTE) Projesi Hakkında

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen “Türkiye’nin Nadir Toprak Elementlerinin Araştırma ve İnovasyon Kapasitesini Geliştirme Projesi”, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde uygulanmaktadır.

Detaylı bilgi için: [www.reeturkiye.com](http://www.reeturkiye.com)

## Projenin Nihai Faydalanıcısı

- Sanayi Genel Müdürlüğü (SGM)

## Proje Ortakları

- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
- Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUNTEAM)

## NTE Projesi’nin Amacı:

NTE Projesi ile Türkiye’nin ulusal NTE Ar-Ge kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, sektörel paydaşların da sürece dahil olduğu talep, arz, geri dönüşüm ve yeni nesil malzemelerin geliştirilmesiyle sürdürülebilir bir NTE tedarik zinciri oluşturulması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında, Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi, Ar-Ge Yeteneklerinin ve İş Ağlarının Geliştirilmesi faaliyetleri planlanmış ve yürütülmektedir.

Projenin Nihai Faydalanıcısı olan Sanayi Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla Ar-Ge kapasiteleri artırılan ve küresel iş ağları genişletilen, akredite Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUNTEAM), uluslararası alanlarda faaliyet göstererek zincirin ilk halkasını oluşturacaktır.

*Sürdürülebilir  
bir tedarik  
zinciri...*



# Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUNTEAM)



Nadir Toprak Elementleri (NTE) ve stratejik hammaddeler üzerine ileri teknoloji ve multidisipliner Ar-Ge faaliyetleri ile geleceğin stratejilerini şekillendiriyoruz.

## Hakkımızda

**Munzur Üniversitesi** bünyesinde 2019 yılında kurulan **Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUNTEAM)** Nadir Toprak Elementleri (NTE) ve stratejik/kritik hammaddeler üzerine geleceğe yönelik stratejiler ve vizyonlar ortaya koymak üzere çalışmalarını yürütmektedir. Merkez, nitelikli insan kaynağı ve ileri teknoloji cihazlarıyla multidisipliner Ar-Ge faaliyetlerine odaklanmaktadır.

2021 yılında "**Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları**" alanında ihtisaslaşan **MUNTEAM, NTE Projesi** ile Ar-Ge kapasitesini geliştirmekte ve son teknoloji ekipman altyapısıyla araştırma ve yenilik süreçlerini desteklemektedir.

## MUNTEAM'ın Ar-Ge Alanları Nelerdir?

**NTE Projesi** kapsamında kurulan laboratuvarlar ile **MUNTEAM** dört ana başlık altında Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.


### MUNTEAM Ar-Ge Alanları:



Türkiye'deki NTE yataklarının jeolojik karakterizasyonu



Çevre dostu elektrokimyasal ve yeşil kimya yöntemleriyle NTE'lerin kazanılması ve saflaştırılması



NTE içeren alaşım, kompozit, optoelektronik malzemeler ve NdFeB mıknatıslar gibi yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi



Danışmanlık ve eğitim hizmetleri

- Türkiye'deki NTE yataklarının jeolojik karakterizasyonu
- Çevre dostu elektrokimyasal ve yeşil kimya yöntemleriyle NTE'lerin saflaştırılması
- NTE içeren katma değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesi
- Danışmanlık ve eğitim hizmetleri

NTE içeren yüksek katma değerli birçok farklı ürün bulunmakta ve üretimleri için çok aşamalı yöntemler uygulanmaktadır. MUNTEAM bünyesinde geliştirilecek NTE içeren katma değeri yüksek ürünler:

- NdFeB mıknatıslar
- Metal alaşımlar
- Kompozit malzemeler
- Opto-elektronik malzemeler

## MUNTEAM Olarak Misyonumuz

Ülke olarak ulusal hedeflerimiz kapsamında dışa bağımlılığın azaltılması ve ileri teknoloji gerektiren ürünler için nadir toprak elementleri başta olmak üzere diğer stratejik/kritik hammaddelerin yerli kaynaklarımızdan elde edilmesi ve ihtiyaç duyulan yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesini sağlamak.


## MUNTEAM Olarak Vizyonumuz

Nadir toprak elementleri ve stratejik/kritik elementlerin sürdürülebilir bir şekilde üretiminden kullanımına bütün değer zincirinde ulusal düzeyde öncü bir kuruluş olmak.



## MUNTEAM Organizasyon Şeması

### NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (DIRECTORATE OF RARE EARTH ELEMENTS APPLICATION AND RESEARCH CENTER)

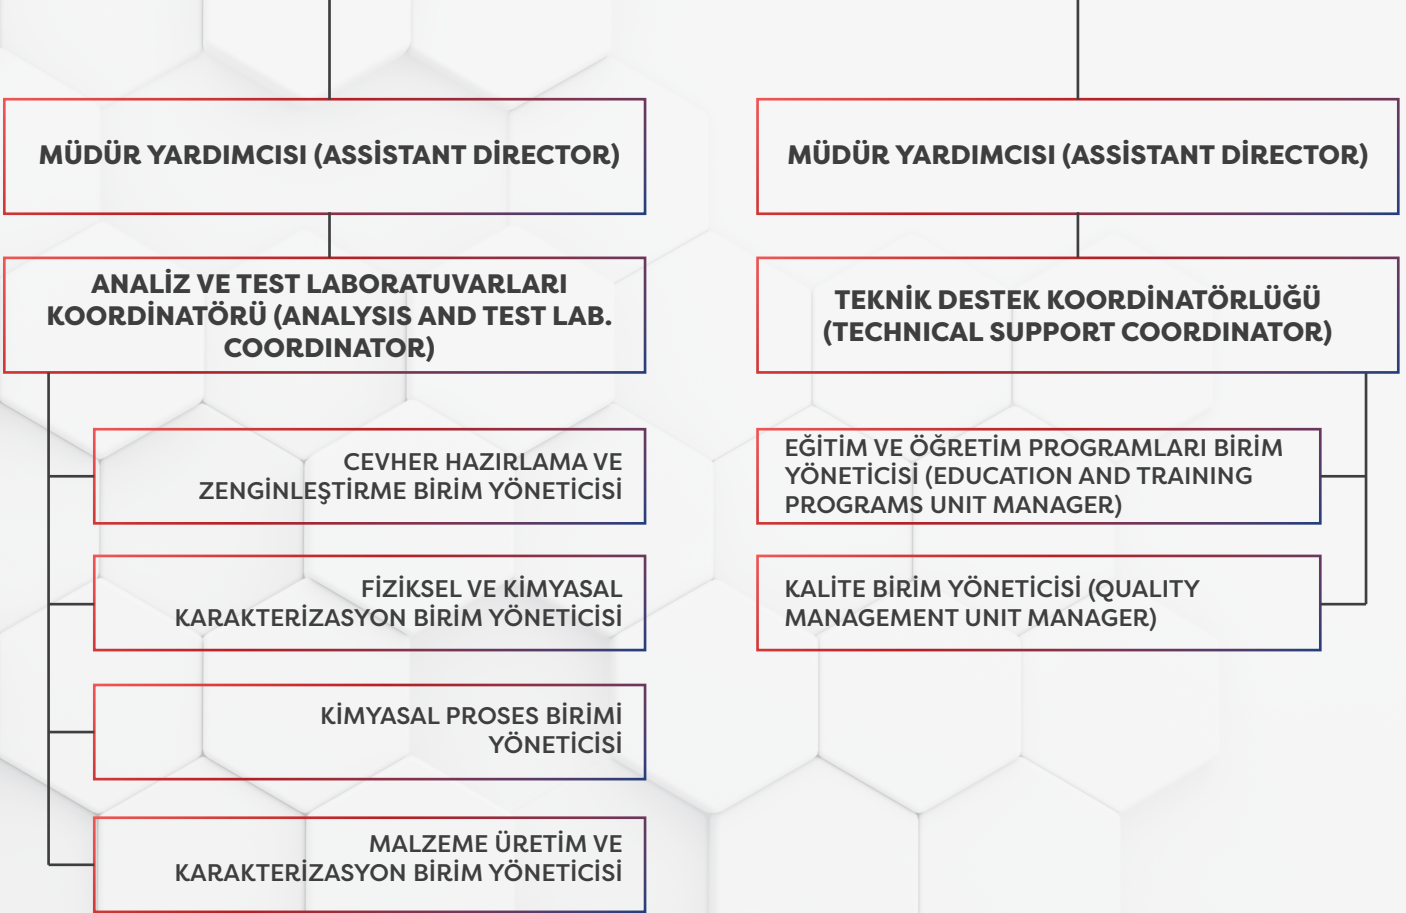



# Birimlerimiz ve Hizmetlerimiz

**MUNTEAM bünyesinde** dört ana birim altında hizmet vermekteyiz.

- **Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Birimi**, araziden alınan cevher örneklerinin hazırlanması ve kimyasal işlemler için uygun hale getirilmesini sağlar.
- **Fiziksel ve Kimyasal Karakterizasyon Birimi**, jeolojik karakterizasyon çalışmalarını yürütür.
- **Kimyasal Proses Birimi**, nadir toprak elementlerinin çevre dostu elektrokimyasal ve yeşil kimya yöntemleriyle saflaştırılmasını gerçekleştirir.
- **Malzeme Üretim ve Karakterizasyon Birimi**, NTE içeren yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve malzeme karakterizasyonunu sağlar.



# Hizmetlerimiz

## CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŐTİRME

*Hammaddeyi deęerli konsantreye dönüőtüren ileri teknoloji!*

Bu birimde yer alan cihazlar, numunelerin kırma, öğütme ve sınıflandırma işlemlerinin yanı sıra, hammaddeden konsantre elde etmek amacıyla flotasyon, sallantılı masa, gravite ayırma ve manyetik ayırma testlerinin gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır.

### Cihazlarımız:

- Denver Tip Flotasyon Makinesi (D-12)
- Manuel Jones Rifle Tipi Seperatör (MNB-25X16)
- Russell Tipi Dönme Eleme Makinesi (REM-X3)
- Bilyalı ve Çubuklu Deęirmen (DBCD-9L)
- Wilfley Tipi Yaş Sallantılı Masa (WSM-50X100)
- Falcon Yarı Kesikli Gravite Seperatör (Ksantratör) (FSBG-55)
- Mozley Tipi Çoklu Gravite Seperatör (SCMG1)
- Yüksek Alan Şiddetli Yaş Manyetik Seperatör (WHIMS-17)
- Düşük Alan Şiddetli Yaş Manyetik Seperatör (LIWMS - 20X15)
- Düşük Alan Şiddetli Kuru Manyetik Seperatör (DDMS - 12X12)
- Üç Pistonlu Jig (JIG-X3P)
- Knelson Yerçekimi Konsantratörü (KGC 50)
- Konik Mikser (KMIX-50L)
- Peristaltik Pompa (PERP-4000)
- Elektroliz (Demcore)
- Vakum Fırın (Mikrotest MVE-60)



## Denver Tip Flotasyon Makinesi (D-12)



Malzemenin içerisinde bulunan değerli metal ve minerallerin yüksek verimlilik ve hassasiyetle ayırma işlemini gerçekleştirir. Değerli minerallerin etkin bir şekilde ayrılmasını sağlamak için öğütülmüş cevher karışımını içeren sıvı içinde hava kabarcıklarına yapışması ve taşınması sistemidir.

- Dijital devir göstergesi ile pervane hızı 0 - 2880 dev/dak arası ayarlanabilmektedir.
- Lineer aktüatör sayesinde, kolon ve bağlı bulunduğu karıştırıcı mili, el kumandasıyla aşağı ve yukarı yönde kolayca hareket edilebilmektedir.
- 0,250 kg ile 2,00 kg arasında malzeme ile çalışma kapasitesine sahiptir.

## Russell Tipi Dönme Eleme Makinesi (REM-X3)



Yüksek performanslı, geniş bir boyut aralığında etkili eleme sağlamak üzere tasarlanan bu makine, Ø600 mm dairesel elekler, her biri 0,25 m<sup>2</sup>'lik eleme yüzeyi sunarak malzemelerin hassas sınıflandırılmasını sağlamaktadır.

- Makineye entegre plastik kapaklı ürün toplama varilleri, her eleme işlemi sonrasında dört ayrı fraksiyonda ürün toplama kolaylığı sağlamaktadır.
- 38 mikrondan 20 mm boyuta kadar istenilen göz açıklığında elek takarak kuru eleme yapma imkanı sunar.
- Titreşimli mal besleyici ve 50 litrelik besleme haznesi ile sürekli ve verimli eleme sağlanırken, üst üste üç adet elek takabilme özelliği dört ayrı fraksiyonda ürün sağlar.

### Manuel Jones Rifle Tipi Seperatör (MNB-25X16)



Jones Riffle Tipi çelik saçtan imal edilmiş, dörde ve ikiye bölüntü kapları, temizleme fırçaları, besleme küreği mevcuttur. Her bir bölücü 4 adet 1/4 bölüntü kapları, 2 adet 1/2 bölüntü kapları mevcuttur.

### Bilyalı ve Çubuklu Değirmen (DBCD-9L)



Bir tambur veya silindir içinde bulunan çelik bilyalar veya çubuklar yardımıyla malzemeleri işler. Özellikle orta sertlikteki veya sert malzemelerin öğütülmesi için uygundur.

- Besleme Miktarı: 500 - 1500 ml
- Ürün Besleme Boyutu: < 8 mm
- Ürün Çıkış İnceliği: < 38  $\mu$ m
- Elektrik Motoru: 1,1 kW, 1400 rpm, 220 V, 3p, 50 Hz

### Wilfley Tipi Yaş Sallantılı Masa (WSM-50X100)



- Salınım hızı 0-365 dev/dak arasında kademesiz olarak ayarlanabilir.
- Genlik, 7,5 mm ve 15 mm olmak üzere farklı kamlar değiştirilerek ayarlanabilir.
- Çelik sac üzerine polyester kaplanarak üretilmiş, açısı ayarlanabilen sarsma tablası.
- Tabla boyutları: 50 x 100 x 35 cm (en x boy x yükseklik).
- Su tüketimi: 200 litre/saat.
- Maksimum kapasite: 25 kg/saat.
- Elektrik motoru: 1.5 hp, 900 dev/dak, 220 V, 3 faz, 50 Hz; V kayışı ve kam sistemi ile tahrik edilmiştir.

### Falcon Yarı Kesikli Gravite Separatör (Konsantratör) (FSBG-55)



Yüksek dönme hızı ve buna bağlı olarak yüksek merkezkaç kuvveti nedeni ile farklı yoğunlukta olan çok küçük tanelerin ayırımında kullanılmaktadır.

- 0-250 kg/saat katı malzeme kapasitesine sahiptir.
- Maksimum pulp kapasitesi 40 lt/dk'dır.
- Uygulanacak santrifüj kuvveti 200 G üstüne ayarlanabilmektedir.
- Motor gücü 0,4 kw (0,5 hp)'dır.

## Mozley Tipi Çoklu Gravite Seperatör (SCMG1)



İnce minerallerin kazanımını ve seçici konsantrasyonunu sağlaması amacı ile kullanılmaktadır.

- Cihazın kapasitesi 0-0,2 t/h aralığındadır.
- Cihazın tambur eğim açısı 0-8 derece aralığında ayarlanabilmektedir.
- Malzeme besleme boyutu 1mm-1 mikron aralığındadır.

## Yüksek Alan Şiddetli Yaş Manyetik Seperatör (WHIMS-17)



Pülpten manyetik malzemelerin geri kazanılması ve uzaklaştırılması için kullanılmaktadır.

- Cihaz, 0,5 – 0,044 mm boyut aralığında çalışmaktadır.
- Cihaz, 0 – 20.000 Gauss güce sahiptir.
- Besleme kapasitesi her bir deney için maksimum 200 gr'dır.
- Cihaz, ağırlıkça %0-20 katı oranındaki pülple çalışmaktadır.

### Düşük Alan Şiddetli Yaş Manyetik Seperatör (LIWMS - 20X15)



Pülpten ferromanyetik malzemelerin geri kazanılması ve uzaklaştırılması için kullanılmaktadır.

- Cihaz 600- 5000 Gauss aralığında çalışabilmektedir.
- 10 mm ve daha ince malzemelerin zenginleştirilmesi için kullanılmaktadır.
- Cihazın çalışma kapasitesi 80kg/h'dır.


### Düşük Alan Şiddetli Kuru Manyetik Seperatör (DDMS - 12X12)



Malzemedan ferromanyetik minerallerin geri kazanılması veya uzaklaştırılması için kullanılmaktadır.

- Cihaz 600- 3000 Gauss aralığında çalışabilmektedir.
- 10 mm veya daha ince malzemelerin zenginleştirilmesi için kullanılır.
- Cihazın çalışma kapasitesi 80kg/h'dır.

## Üç Pistonlu Jig (JIG-X3P)

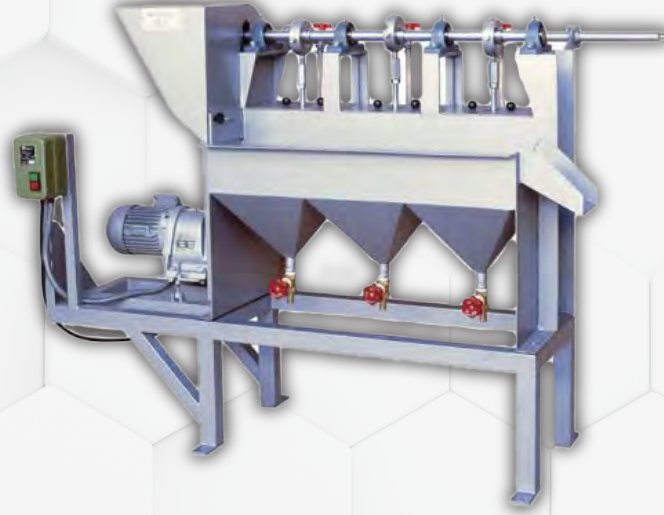

İri taneli kömür ve maden cevherlerinin laboratuvarlarda zenginleştirme olasılığının saptanmasında kullanılır.

- Pulsasyon hızı 0-300 dev/dak arası kademesiz olarak ayarlanabilir.
- 200 x 275 mm ebadında 3 adet pistonlu, 1mm, 2mm, 3mm, 4mm açıklıklı alt elekler.
- Çelik konstrüksiyon gövdeli her biri 200 x 275 mm ebadında üç kompartımanlı ve pistonlu.
- Pulsasyon eksantirik mili dönüş hızı 0 - 300 dev/dak arası elektronik motor hız kontrol cihazı ile kademesiz ayarlanabilmektedir.
- 1 hp, 1400 dev/dak, 380 V, 3p, 50 Hz elektrik motorlu ve redüktör tahrikli.
- Nominal Kapasite <150 kg/saat (Malzemenin cinsine ve iriliğine bağlı olarak).

### Knelson Yerçekimi Konsantratörü (KGC 50)



- 0-50 kg/saat arasında değişen kapasiteye sahiptir.
- Pülp besleme katı oranı % 0-75 arasında değişmektedir.
- Koni üst çapı 3 inch'dir.
- Santrifüj kuvvet 40-200 G arasında ayarlanabilmektedir.
- Motor gücü 0.2kW.
- Besleme tane boyutu max. 2 mm'dir.
- Kontrol eleği cihaz üzerinde mevcuttur.

### Konik Mikser (KMIX-50L)



- Karıştırıcı hızı 0-1400 dev./dak. arasında hız kontrol cihazı ile kademersiz ayarlanabilmektedir.
- AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş gövde ve mekanik karıştırma mili ve pervanesi bulunmaktadır.
- Elektrik motoru: 1 hp, 1400 dev/dak, 220 V, 3p, 50 Hz'dir.

## Peristaltik Pompa (PERP-4000)


















- 0,25 kW, 900 dev/dak, 380 V, 3 p, elektrik motorlu.
- 5-4000 ml/dak arası kademesiz ayarlanabilir akış debisi.
- 1,5-2 mm et kalınlığındaki (iç çap 5-10 mm arası) 1 adet kauçuk hortuma uygun basma haznesi kovanı vardır.

## Vakum Fırın (Mikrotest MVE-60)



Hassas Dijital PID denetleyici ve hassas sıcaklık sağlayan yüksek sıcaklık koruması, otomatik açma fonksiyonları bulunmaktadır.

- Sıcaklık ayarı 5 - 250°C ayarlanabilmektedir.
- Vakum derecesi 10 - 760 mmHg.
- Isıtma Sensörü 1250W.
- Kapasite 30L- 60L.

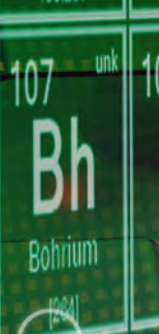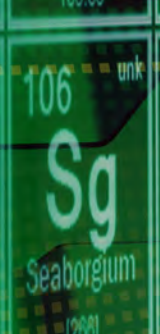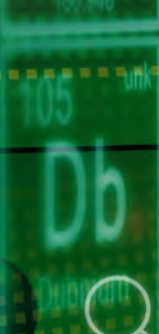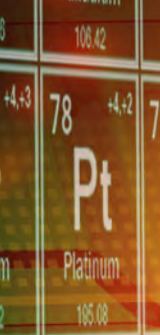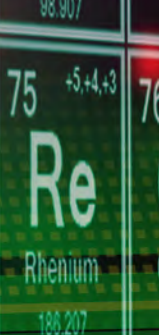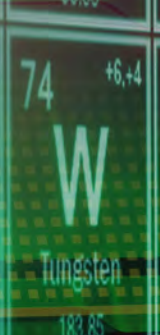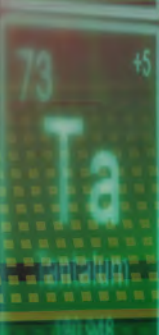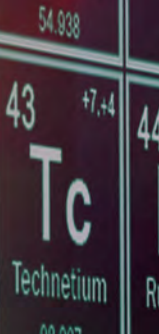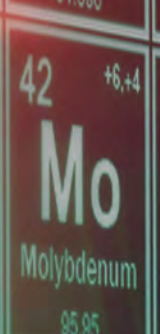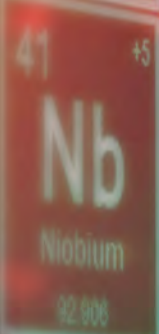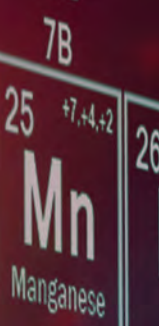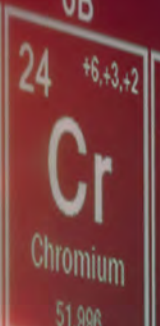

## FİZİKSEL VE KİMYASAL KARAKTERİZASYON

### Doğru analiz ve görüntüleme

Son teknoloji fiziksel ve kimyasal karakterizasyon cihazlarıyla cevher, konsantre ve malzemelerin fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri analiz edilmekte; görüntüleme teknikleriyle malzemelerin iç yapısı ve morfolojik özellikleri belirlenmektedir.

### Odaklanmış İyon Demeti Taramalı Elektron Mikroskobu (FIB-SEM, Thermo Fisher Scientific, Scios 2 DualBeam)



**Thermo Scientific Scios 2 DualBeam**, manyetik ve iletken olmayan malzemeler de dahil olmak üzere çeşitli örnekler için üstün numune hazırlama ve 3D karakterizasyon sunan, ultra yüksek çözünürlüklü, analitik odaklı bir iyon demeti taramalı elektron mikroskobudur (FIB-SEM).

Yenilikçi özellikleri sayesinde verimliliği, hassasiyeti ve kullanım kolaylığını artıran bu sistem, hem akademik hem de endüstriyel araştırma ortamlarında ileri düzey analizler için ideal bir çözüm sunar.

#### Öne Çıkan Özellikler:

##### 3B karakterizasyon performansı

**3B karakterizasyon** genellikle numunenin yüzey altı yapısını ve özelliklerini anlamak için gereklidir. Thermo Scientific Auto Slice & View 4 (AS&V4) Yazılımı, maksimum malzeme kontrastı için geri saçılmış elektron (BSE) görüntüleme, kompozisyon bilgisi için enerji dağılımlı spektroskopi (EDS) ve mikro yapısal bilgi için elektron geri saçılma kırınımı (EBSD) ile yüksek kaliteli, tam otomatik 3B veri kümeleri sağlar.

## Geri saçılmış elektron ve ikincil elektron görüntüleme

Yenilikçi NICol elektron kolonu, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve algılama yeteneklerinin temelini oluşturur. STEM modunda 30 keV veya daha düşük enerjilerde çalışarak geniş bir koşul yelpazesiyle mükemmel nanoskalalı detaylar sunar. Thermo Scientific Trinity Algılama Sistemi, açışal ve enerji seçici SE ve BSE görüntülemesini aynı anda sağlar.

## TEM numune hazırlama

Çeşitli malzemeler için yüksek çözünürlüklü S/TEM numuneleri hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanabilir. Yüzey hasarını en aza indirmek için düşük enerjili iyonlarla son parlatma gereklidir. Thermo Scientific Sidewinder HT FIB kolonu, yüksek voltajlarda yüksek çözünürlük sağlarken düşük voltajlarda da etkili performans göstererek kaliteli TEM lamelleri üretir.

### Elektron ışını çözünürlüğü

- Optimum WD
  - 30 keV STEM'de 0,7 nm
  - 1 keV'de 1,4 nm
  - 1 keV'de 1,2 nm, ışın yavaşlatma ile

### Elektron ışını parametre uzayı

- Işın akımı aralığı: 1 pA ila 400 nA
- İniş enerjisi aralığı: 20\* eV – 30 keV
- Hızlanma voltaj aralığı: 200 V – 30 kV
- Maksimum yatay alan genişliği: 7 mm WD'de 3,0 mm ve 60 mm WD'de 7,0 mm

### İyon optiği

- İvmelenme gerilimi: 500 V – 30 kV
- Işın akımı aralığı: 1,5 pA – 65 nA
- İyon ışını çözünürlüğü: Seçici kenar yöntemi kullanılarak 30kV'da 3,0 nm

### Dedektörler

- Trinity Algılama Sistemi (lens içi ve sütun içi)
- Everhart-Thornley SE Dedektörü (ETD)
- İkincil iyonlar (SI) ve elektronlar (SE) için yüksek performanslı iyon dönüşümü ve elektron (ICE) dedektörü
- Geri çekilebilir düşük voltajlı, yüksek kontrastlı, segmentli katı hal geri saçılmış elektron dedektörü (DBS)
- BF/DF/HAADF segmentli geri çekilebilir STEM 3+ dedektörü
- Numune ve hazneyi görüntülemek için IR kamera
- Oda içi Nav-Cam örnek navigasyon kamerası
- Entegre ışın akımı ölçümü

## Lazer Başlıklı Yüksek Çözünürlüklü İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (LA-HR-ICP-MS, Teledyne Foton Makinesi-Thermo Scientific Element XR)



Element XR/2 sistemi olup yüksek hassasiyet ve geniş dinamik aralık sunan ileri teknolojiye sahip bir cihazdır.

### Öne Çıkan Özellikler:

- Konsantrik nebulizatör ile yüksek hassasiyet: 1 ppm'de  $1 \times 10^9$  cps üzeri sayım hızı.
- Müdahale edilmeyen nuklidler için algılama sınırı: 1 ppq'nin altında.
- Karanlık gürültü: 0.2 cps'nin altında.
- Geniş dinamik aralık:  $10^{12}$  doğrusal değere kadar otomatik kazanç kalibrasyonu ile.
- Kütle çözünürlüğü:
  - %10 çukur eşdeğeri ve %5 tepe yüksekliğinde: 300, 4000 ve 10,000.
  - Tam genişlikte yarım maksimum (FWHM) için: 600, 8000 ve 20,000.
- Sinyal kararlılığı:
  - 10 dakika içinde %1 RSD'nin altında.
  - 1 saat içinde %2 RSD'nin altında.
- Manyetik tarama hızı: m/z 7'den 240'a ve tekrar 7'ye 150 ms'den hızlı.
- Elektriksel tarama hızı: Kütle aralığından bağımsız olarak 1 ms atlama süresi.
- Oksit ve çift yüklü iyon oranları:
  - $\text{BaO}^+/\text{Ba}^+ < 0.002$
  - $\text{Ba}^{2+}/\text{Ba}^+ < 0.03$

## ICP-MS-HR Sistemi ile Entegre IRDA Lazer Ablasyon Sistemi



### Yüksek hassasiyet, yüksek hız, uzun ömür

IRDA Lazer Ablasyon Sistemi, 193 nm ultra-kısa darbe teknolojisine sahip kompakt ve hava soğutmalı excimer lazerle donatılmıştır. 300 Hz'e kadar çalışma kapasitesi sunan bu sistem, darbe stabilitesinde %2 RMS'nin altında performans gösterir ve uzun ömürlü kullanımıyla 2 milyar atış garantisi (tipik olarak 4 milyar) sağlar.

### Enerji Kontrolü ve Ayarları:

- Enerji yoğunluğu:  $0.5 \text{ J/cm}^2$  ile  $15 \text{ J/cm}^2$  arasında,  $0.1 \text{ J/cm}^2$  adımlarla ayarlanabilir.
- Çalışma modları: Tek atış, sürekli ve sabit dozaj modları.
- Opsiyonel Exicheck yazılımı ile ArF gaz değişimi otomatik olarak kontrol edilebilir.

### Lazer Nokta Boyutları:

- Daire şeklinde:  $1 \mu\text{m}$  ile  $140 \mu\text{m}$  çapında.
- Kare şeklinde:  $5 \mu\text{m}$  ile  $135 \mu\text{m}$  boyutlarında.
- Ek olarak çapraz ve yarık nokta seçenekleri mevcuttur.

### Enerji Ölçümü ve Işın Yolu:

- eQC opsiyonu ile ablasyon işlemi sırasında enerji yerinde ölçülebilir.
- Hedef ayna, örnek tutucuya entegre edilmiştir.
- Lazer ışın yolu, N2 basınçlandırması ile sınıf-1 göz güvenliği standartlarına uygundur.
- Kullanıcı tarafından değiştirilebilen 193 nm aynalar ve yüksek verimli ışın yolu ile donatılmıştır.
- Lazer yolu, asferik üçlü lens seti ve video yolunda akromatik optik çiftlerle optimize edilmiştir.

## İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES, Thermo Scientific iCAP Pro XP Duo)



**ICP – OES** günümüzde pek çok numune tipinde bulunan elementlerin ve bileşenlerin eş zamanlı analizi için kullanılan en popüler yöntemlerden biridir. Numunenin yüksek sıcaklıktaki plazmaya püskürtülmesiyle gaz fazına geçerek uyarılan elementlerin yaydıkları spesifik dalga boylarına kıyasla kalibrasyon eğrileri çizilir ve tespit edilen elementlerin konsantrasyonları tayin edilir.

*En zorlu örnek matrislerini  
bile analiz edin!*

Zorlu örnek matrislerinde güçlü çok elemanlı analiz yeteneği sunan iCAP PRO Serisi, hızlı ve güvenilir veri üretimini sağlar.

- **Yüksek Çözünürlüklü Optikler:** Çift geçişli optikler ve CID dedektörü, 200 nm'de <7 pm çözünürlükle karmaşık numunelerin kolay analizini mümkün kılar.
- **Tam Eş Zamanlı Erişim:** Yüksek hızlı CID dedektörü ile 167,021 - 852,145 nm arası spektruma tam erişim, yeniden analiz ihtiyacını azaltır.
- **Tutarlı Sonuçlar:** Geniş fotoaktif alan ve yüksek hızlı elektronik ile tüm dalga boylarında güvenilir ölçümler sağlar.

## Dalga Boyu Dağılımlı X Işını Floresans Spektrometresi (WD-XRF, Malvern Panalytical Zetium)



### **X-ışınının yoğunluk noktalarını gösteren bir spektrum**

WD-XRF cihazı, genel olarak foton-madde etkileşmesi sonucu meydana gelen karakteristik X-ışınları ve saçılma fotonlarının nicel ve nitel değerlendirilmesinde kullanılır. Bununla birlikte, XRF kantitatif bir tekniktir. Numunedeki atomlar tarafından yayılan X-ışınları bir dedektör tarafından toplanır ardından analiz kısmında işlenerek enerjiye karşı X-ışınının yoğunluk noktalarını gösteren bir spektrum oluşturulur. Enerji piki elementin, pik alanı veya yoğunluğu, numunedeki elementin miktarının bir göstergesidir.

### **Güvenilir sonuçlar ve sağlam operasyon için Akıllı Zetium**

Zetium XRF spektrometresi, alt ppm'den Be'den Am'a kadar element analizleri için yüksek kaliteli tasarım ve yenilikçi özelliklerle, en zorlu proses ve kalite kontrolün yanı sıra Ar-Ge uygulamalarını da karşılamaktadır.

Devrim niteliğindeki platform, WDXRF ve EDXRF'nin bir entegrasyonu olan SumXcore teknolojisini bünyesinde barındırmaktadır.

## Ultraviyole-Görünür-Yakın Kızılötesi Spektroskopisi (UV-VIS-NIR, Agilent Technologies Cary 5000)



UV-Vis-NIR spektrofotometresi, 175–3300 nm aralığında mükemmel fotometrik performansa sahip yüksek performanslı bir UV-Vis ve NIR spektrofotometresidir.

- **En Son Nesil PbSmart Dedektörü:** Malzeme bilimi araştırmalarında hassasiyeti artıran ve NIR'deki dağınık ışığı azaltan PbSmart dedektörü, güçlü bir analiz aracı sunar.
- **Cary WinUV Yazılımı:** Modüler, Windows tabanlı yazılım ile güçlü analizler ve aksesuar kontrolü sağlar.
- **Işık Kaynağı:** Tungsten halojen ve döteryum ark ile 2.000 nm/dak UV ve 8.000 nm/dak NIR tarama hızı.
- **Spektral Bant Genişliği:** UV-Vis için 0,01 - 5,00 nm, NIR için 0,04 - 20 nm; Dalga boyu aralığı 175 - 3300 nm.
- **Geniş Numune Bölmesi:** Büyük aksesuarlar ve entegre küreler için genişletilebilir, LockDown mekanizması ile hızlı ve doğru aksesuar değişimi sağlar.

## Parçacık Boyutu Zeta Potansiyel Analizörü (Malvern Panalytical Zetasizer Ultra Red Label)



*Dünyanın en gelişmiş ışık saçılım sistemi*

Yeni Zetasizer Ultra, parçacık ve moleküler boyutu, parçacık yükü ve parçacık konsantrasyonunun ölçümü için en gelişmiş sistemdir ve Zetasizer Advance serisindeki en akıllı ve esnek cihazı temsil eder.

Amiral gemisi modeli olarakta adlandırılan sistem, kullanım kolaylığı, analiz hızı ve veri güvenilirliği açısından ZS Xplorer yazılımının sunduğu tüm avantajlardan yararlanır ve ayrıca, numuneleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için **Çok Açık Dinamik Işık Saçılımı (MADLS)** ve parçacık konsantrasyonu olmak üzere iki benzersiz ölçüm yeteneği sunar.

- Partikül boyut ölçümü için numunenin maksimum boyut aralığı (çap): 0.3 nm – 10 µm
- Zeta potansiyeli ölçümü için numunenin maksimum boyut aralığı (çap): 3.8 nm – 100 µm

**Dinamik Mekanik Analiz (DMA,  
Netzsch Geratebau GmbH DMA 242  
Artemis)**




*Malzemelerinizi geleceğin  
teknolojisiyle analiz edin!*

Dinamik Mekanik Analiz (DMA), başta polimerler olmak üzere malzemelerin visko-elastik özelliklerini belirlemek için kullanılan bir testtir. Test numunesine istenilen sıcaklık değişimi esnasında sinusoidal fonksiyona benzer, zamana ve frekansa bağlı olan mekanik bir kuvvet uygular ve numunenin enerji depolama ve kayıp modüllerinin sayısal olarak değişimi elde edilir.

- **Yük Kapasitesi:**  $\pm 12\text{N}$
- **Sıcaklık Aralığı:**  $-160^{\circ}\text{C}$  ile  $600^{\circ}\text{C}$
- **Frekans Aralığı:**  $0,01 - 100\text{ Hz}$
- **Test Modları:** Üç nokta eğilme, çekme, basma ve kayma
- **Sıcaklık Artış Hızı:**  $0,01^{\circ}\text{C/dakika}$  ile  $20^{\circ}\text{C/dakika}$


**Diferansiyel taramalı  
kalorimetri (DSC, Linseis HDSC  
PT 1600)**

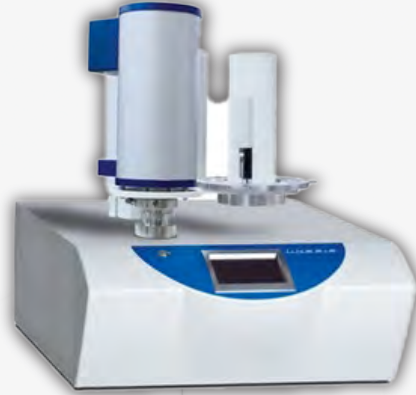

DSC cihazı, bir malzemenin ısı kapasitesinin (Cp) sıcaklıkla nasıl değiştiğini inceleyen bir termal analiz tekniğidir. Kütleri bilinen bir numune ısıtılır veya soğutulur ve ısı kapasitesindeki değişiklikler ısı akışında değişiklikler olarak izlenir. Bu teknikte, referans ile numuneden gelen veya uzaklaşan ısı farkı sıcaklığa veya zamana bağlı olarak gösterilir. Bu sayede, söz konusu malzemenin erime noktasını, cam geçiş sıcaklığını ve malzemenin fazlarında meydana gelen değişimleri belirlemek için kullanılan bir analiz cihazıdır.

- **Sıcaklık aralığı:**  $-150^{\circ}\text{C}$  ila  $1600^{\circ}\text{C}$
- **Sensör Türleri:** DSC – Cp
- **Isıtma oranları:**  $0,001\text{ K/dak}$  ...  $50\text{ K/dak}$
- **Soğutma oranları:**  $0,001\text{ K/dak}$  ...  $50\text{ K/dak}$
- **Ölçüm aralığı:**  $\pm 2,5\text{ mW}$  ila  $\pm 250\text{ mW}$

## 3D İnterferometrik Profilometri (Fytronix FY-PRO 200)

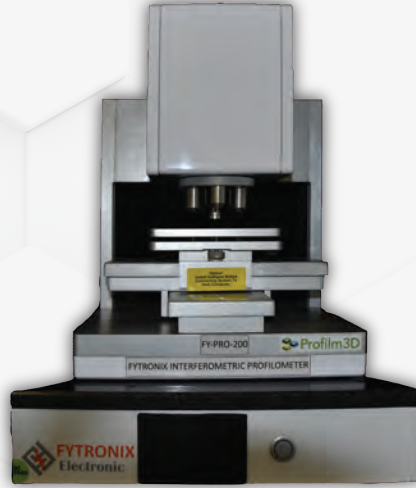

### Yüksek teknolojiyle 3D görüntüleme ve yüzey analizi

Profil3D yazılımı ile gelen profilometre görüntü işleme operatörleri arasında düzleme alma, filtreleme, parça çıkarma, FFT ve kırpma gibi özellikler sunar. Analiz işlevlerinden bazıları ise adım yüksekliği, çizgi, dikdörtgen ve histogram yöntemleri ile hesaplanabilir ve farklı malzemeler arasında düzeltmeler yapılabilir. Ayrıca, yüzey pürüzlülüğü ölçümleri çizgi ve alan bazlı olarak yapılabilir ve 47 farklı ASME/EUR/ISO pürüzlülük parametresi desteklenir.

Grafik arayüzü, renk ölçeği, 3D aydınlatma seçenekleri ve Z ölçeği kontrolü gibi özelliklerle donatılmıştır. Kullanıcılar manuel görüntü işlemleri yapabilir ve tariflerle özelleştirilmiş ölçümleri tek tıklamayla gerçekleştirebilir.

- **İsteğe Bağlı Özellikler:** Gerçek renkli 3D görüntüleme ve TotalFocus modu ile sınırsız alan derinliği.
- **İnce Film Kalınlık Ölçümü:** 35 nm ve üzeri film kalınlıklarını ölçebilir, 50 nm - 10 mm aralığında hassas ölçümü.
- **ISO 25178 Uyumlu:** İnce detayların yüksek çözünürlükte görüntülenmesi.

## Taramalı Elektrokimyasal Prob Sistemi (Heka ELP)



**Yüksek çözünürlükte elektrokimyasal analizle yüzeylerinizi ve malzemelerinizi derinlemesine keşfedin.**

HEKA ELPScan, çeşitli numune ve malzemelerin lokal reaktifliğinin ve topografisinin yerinde yüksek çözünürlüklü mikroskopik görüntülerini elde etmek için bir ultra mikro elektrot ve/veya nano-/mikropipet kullanan benzersiz bir elektrokimyasal taramalı prob mikroskobu (e-SPM) sistemidir.

- ELP 1 sistemi kompakt ve çok yönlü bir elektrokimyasal tarama platformudur.
- Her ekseninde bulunan doğrusal kodlayıcı, boşlukları ortadan kaldırmak için kapalı devre düzenlemesiyle gerçek zamanlı konum kontrolüne olanak tanır.
- Hem makro boyutlu hem de mikro ölçekteki alt tabakalar için elektrokimyasal empedans (EIS) ölçümleri destekleyen harici bir EIS modülü ile donatılmıştır.
- Sistem, 2D çizgi taraması ve 3D matris taraması gibi protokol kontrollü EIS haritalama özelliklerine sahiptir. Sabit noktalarda frekans spektrumu taraması yapılabilir ve sonuçlar Bode ve Nyquist grafiklerinde gösterilir.
- SECCM modunda, mikro-EIS Matris Haritalaması, mikron ve alt-mikron çözünürlükte yüzeyin yerel empedansını ve topografik yüksekliğini aynı anda görüntüleme kapasitesine sahiptir.
- EIS frekans aralığı 10  $\mu$ Hz ile 2 MHz arasındadır (isteğe bağlı olarak 4 MHz'e kadar).
- Frekans doğruluğu ve çözünürlüğü %0.0025'in altındadır ve dekad başına 10,000 adım içerir.
- Kontrol edilen akım  $\pm 2.0$ A, kontrol edilen voltaj  $\pm 12$ V'a kadar çıkabilir. AC genliği ise 0-1V arasında ayarlanabilir. Çalışma modları arasında POT, GAL, OCP ve ZRA bulunur, hem yüzey hem de topraklı modlarda çalışabilir.
- Dünyanın ilk asimetrik çift kanallı bipotansiyostatına sahiptir, farklı akım aralıkları ile her iki kanal bağımsız çalışabilir.

- 16-bit 200 kHz AD/DA arayüzüne sahip olup 5  $\mu$ s örnekleme süresine sahiptir.
- Bipotansiyostatın voltaj aralığı  $\pm 10V$  olup, akım aralığı  $\pm 20$  nA'dan  $\pm 100$  mA'ya kadar geniş bir aralık sunar.
- Potmaster yazılımı, SECM tarama modlarında 2D/3D protokol kontrollü matris taraması, sabit yükseklik veya mesafede tarama gibi gelişmiş özellikler sunar.
- Elektro-kimyasal tekniklerde geri besleme, jenerasyon-koleksiyon ve redoks yarışması gibi modlar desteklenir. Ayrıca klasik voltametri, korozyon teknikleri ve spektroelektrokimya gibi geniş bir teknik yelpazesi mevcuttur.



## Yüksek Empedanslı Katı Malzemelerin Elektriksel Karakterizasyonu (Biologic MTZ-35)



Geniş bir frekans aralığı (10  $\mu$ Hz – 35 MHz) ve yüksek doğruluk seviyeleri (%0,1 genlik, %0,05 faz) ile Biologic MTZ-35 empedans analizörü, malzeme biliminin gerektirdiği en zor ölçümleri bile ele almak üzere tasarlanmıştır.

MTZ-35, malzemelerin elektriksel karakterizasyonu için entegre çözümlerde temel araçtır. Bu çözümler, geniş uygulama alanları ve sıcaklık aralıkları için tasarlanmıştır.

### Sistem bileşenleri:

- MTZ-35 empedans analizörü
- Sıcaklık kontrol ünitesi
- Numune tutucu
- MT-Lab yazılımı

- MT-Lab arayüzü, geniş bir sıcaklık aralığında (-40°C ila 1100°C) çeşitli sıcaklık kontrol sistemlerini (HTF-1100 fırını, ITS, vb.) kontrol etmeye olanak tanır. Ayrıca empedans ölçümü ve eşdeğer devrelerle EIS (Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi) verilerinin modellenmesini sağlar.
- 35 MHz Empedans Analizörü, Malzemelerin elektriksel karakterizasyonu için gelişmiş ve eksiksiz çözümdür. Seramikler, katı oksitler, polimerler, kauçuklar, dielektrikler, kompozitler, güneş/fotovoltaik hücreler, yarı iletkenler B uygulama alanları vardır. Ölçüm aralıkları bakımından, frekans 10  $\mu$ Hz ila 35 MHz, Endüktans 10 nH ila 10 kH, Kapasitans 1 pF ila 1000  $\mu$ F, Direnç 1 m $\Omega$  ila 500 M $\Omega$  olarak sıralanabilir.

## Eriyik Akış İndeksi (Göttfert mi2.1)



Malzemelerin Eriyik Akış İndeksi, ürünün işlenmesinde ve kalıplanmasında kritik öneme sahiptir. Bu nedenle kontrolü en önemli parametrelerden biridir. Eriyik akış test cihazı, Eriyik Akış Hızı (MFR) ve Eriyik Hacim Oranının (MVR) kolay ve doğru bir şekilde ölçülmesini sağlayacaktır. Sahip olduğu farklı kütleler sayesinde farklı kütleler ile testler yapılabilmektedir. Cihaz ile 300°C'ye kadar testler yapılabilmektedir.

## Solar Simülatör Sistemi (Fytronix FYSM 2020)



*Güneş pillerinin  
doğru ve  
güvenilir analizi.*

Solar Simülatör Sistemi, boya duyarlı güneş pilleri, kuantum noktalı güneş pilleri, organik güneş pilleri, perovskit güneş pilleri, silikon güneş pilleri, ince film güneş pilleri, fotodedektörler ve fotodiyotlar gibi aygıtların fotovoltajik ve fotoiletken özelliklerini analiz etmek için tasarlanmıştır. Sistem,  $1-100 \text{ mW/cm}^2$  ışık şiddeti altında ASTM E 927-05 standardına uygun olarak çalışır ve  $380-1100 \text{ nm}$  spektral aralığı ile  $0,1 \text{ W/m}^2$  çözünürlüğe sahiptir.

Sistem, oda sıcaklığında şu ölçümleri gerçekleştirebilmektedir:

- Akım-Voltaj (I-V)
- Güç-Voltaj (P-V)
- İletkenlik-Voltaj (G-V)
- Fotoakım-Zaman (I-t)
- Açık Devre Voltajı-Zaman (Voc-t)
- Kısa Devre Akımı-Zaman (Isc-t)
- Frekansa Bağlı Arayüz Durumları (Dit-f)
- Seri Direnç (Rs)
- Kapasitans-Voltaj (C-V)

## Çok Kanallı Bipotansiyostat Sistemi (Ivium n-Stat)



Her kanal, standart entegre empedans analizörü (10  $\mu$ Hz – 250 kHz) ile donatılmıştır.

- Kanal başına sağlanan akım ve voltaj seçenekleri:
  - $\pm 2.5A / \pm 10V$
  - $\pm 5A / \pm 10V$
  - $\pm 2A / \pm 20V$
  - Çift kanal: 2 x  $\pm 500$  mA /  $\pm 10V$  veya 2 x  $\pm 2.5A / \pm 10V$
- Cihaz geniş uygulama alanlarına sahiptir; batarya testleri, korozyon ölçümleri ve elektrokimyasal uygulamalar için uygundur.
- Yüksek güç kapasitesi ( $\pm 5A$ ) ve düşük akım aralığı (10 nA'ye kadar) sayesinde geniş bir dinamik aralık sunar.
- Özellikle batarya ve yakıt hücresi çalışmaları için çok kanallı uygulamalar için idealdir.
- Bilinen tüm elektrokimyasal teknikleri içerir ve 10  $\mu$ Hz – 1 MHz aralığında empedans frekans ölçümleri için FRA'ya sahiptir.
- Bütün ölçümler ve veri işleme, cihazla birlikte gelen yazılım aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
- Cihazın uyumlu voltajı ve akımı (maksimum akım ve potansiyel) kullanıcı tarafından ayarlanabilir. Bu sayede hem örneklerin korunması sağlanır hem de tehlikeli durumlardan kaçınılır.
- Çoklu analog ve dijital giriş/çıkışlar sayesinde çevresel cihazlar periferel port üzerinden izlenip kontrol edilebilir. Bu özellik tamamen yazılım üzerinden yönetilir.
- Ivium-n-Stat, her bir kanal için Bipotansiyostat opsiyonu sunmaktadır.
- Otomatik akım seçimi ve potansiyel - empedans frekansı aralıkları: 10 nA – 10 A / 1 mV – 10 V (20 V) / 10  $\mu$ Hz – 250 kHz.
- Otomatik gürültü filtreleme ve potansiyostatik ile galvanostatik modlar için stabilite seçenekleri mevcuttur.
- Gerçek zamanlı veri işleme hızı: 500 pnts/s.
- Kazanım oranı: 100,000 pnts/s.
- Tarama hızı: 1  $\mu$ V/s ile 10,000 V/s arası.
- Minimum zaman aralığı/çözünürlük: 10  $\mu$ s.

## Yüksek Empedans Elektrokimyasal Potansiyostat Sistemi (Ivium Stat.h)



Cihaz, özellikle korozyon ölçümleri gibi geniş dinamik aralık gerektiren elektrokimyasal araştırma uygulamaları için uygundur.

- $\pm 2A$  güce ve  $1pA$  tam ölçeğe kadar düşük akım aralıklarına, ayrıca  $\pm 50V$  uyumluluk voltajına sahiptir.
- Tüm standart elektrokimyasal teknikleri içeren eksiksiz bir paket sunar.
- $10 \mu Hz$  ila  $8 MHz$  arasında EIS ölçümleri yapabilen entegre yüksek performanslı bir Frekans Tepki Analizörü (FRA) bulunur.
- Cihazın maksimum akımı ve potansiyeli operatör tarafından tanımlanabilir, bu sayede değerli numuneler korunur ve güvenlik riskleri önlenir.
- Birden fazla analog ve dijital giriş/çıkış portu sayesinde çevresel ekipmanlar izlenip kontrol edilebilir.
- Otomatik akım aralığı seçimi:  $1 pA - 10 A / 1 mV - 10 V (50 V)$ .
- Otomatik değişken gürültü filtresi ve potansiyostat/galvanostat kararlılık ayarları ile donatılmıştır.
- Akım, potansiyel ve 8'e kadar çevresel analog sinyalin eşzamanlı edinimi,  $500 pnt/s$ 'ye kadar gerçek zamanlı veri görüntüleme sağlar.
- Cihaz,  $100.000 pnt/s$ 'ye kadar veri edinimi kapasitesine sahiptir ve bu veriler cihaz belleğinde saklanır.
- Tarama hızları:  $1 \mu V/s - 10.000 V/s$ .
- Minimum zaman aralığı:  $10 \mu s (0,125 \mu s \text{ çözünürlük})$ .

- Otomatik ayarlanan filtreler, kazanç amplifikatörleri ve DC çıkarma özellikleri ile sonuç optimizasyonu sağlar.
- IviumStat.XRe, Ivium'un kendi yazılımı IviumSoft aracılığıyla kontrol edilir. Bu yazılım, cihaz kontrolü, veri yönetimi ve analizi, çevresel cihaz kontrolü gibi birçok işlev sunar.
- IviumSoft, ayrıca LabVIEW™, C++, Delphi vb. ile arayüz oluşturabilir ve bu programlardan kontrol edilebilir.



### Öne Çıkan Özellikler:

- Maksimum uyumluluk akımı:  $\pm 2A$
- Uyumluluk voltajı:  $\pm 50V$
- Maksimum uygulanan voltaj:  $\pm 50V$
- Elektrot bağlantıları: 4 adet (WE, CE, RE, S ve GND)
- Bağlantılar: 4 mm muz fişleriyle sağlanır.
- Potansiyostat bant genişliği: 8 MHz
- Tepki filtreleri: 1 MHz, 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 10 Hz
- Sinyal edinimi: Çift kanallı 24-bit ADC
- Veri edinim kapasitesi: 100.000 örnek/saniye

## KİMYASAL PROSES BİRİMİ

Bu birimde liç, çöktürme gibi konvansiyonel hidrometalurjik yöntemlerin yanında derin ötektik ve iyonik sıvılar ile yenilikçi çevre dostu elektrokimyasal ve yeşil kimya yöntemleri ile NTE'lerin saflaştırılması sağlanmaktadır.



- Mikrodalga Çözdürme Sistemi (Milestone Ethos Up)
- Azot Gazı Jeneratörü ve Hava Kompresörü (Berg Kompressoren GmbH Nitroberg 500 ve Berg Kompressoren GmbH KOMPBERG® BSDK)
- Santrifüj (Hermle Z 327 K)
- Ultra Derin Dondurucu (Eppendorf CryoCube F740hi)
- 3D Yazıcı (Ultimaker S5)
- Kül Fırını (Mikrotest MKF-10)
- Elek Seti (Fritsch Analysette 3 Pro)
- Peristaltik Pompa (Heidolph Hei-FLOW Expert 120 Multi)
- Kimyasal Depolama Dolabı (Asecos S Classic 90 model S90.196.120)
- Termostatik Çalkalamalı Su Banyosu (Mikrotest MCS-30)
- Ultrasonik Su Banyosu (Mikrotest MUB-28)
- Otomatik Mikropipet (Brand Transferpette S)
- Soğutma/Isıtma Sirkülatörü (Mikrotest MSS-07)
- Orbital Çalkalayıcı (Edmund Bühler SM 30 A control)
- Buzdolabı (Uğur UES 535 D2K NF)
- Mikro Santrifüj (Hermle Z 167 M)
- Manyetik Karıştırıcı (Heidolph Hei-Connect)
- Erime Noktası Aparatı (Kruss M5000)
- Multimetre (Elmetron CX-461)
- pH metre (Elmetron CP-401)
- Mekanik Karıştırıcı (Heidolph Hei-TORQUE Expert 400)
- Hassas Teraziler (Radwag AS 220.R2 Plus)
- Çeker Ocak (Mikrotest MCO-180)
- Vorteks (Velp ZX3)

### *Optoelektronikten kompozitlere, yenilikçi çözümler*



Malzeme Üretim ve Karakterizasyon Birimlerinde şekil hafızalı ve yeni nesil alaşımlar, polimer ve seramik tabanlı kompozitler, fotodiyot, foto veya LED gibi optoelektronik malzemeler ve NdFeB mıknatısların üretimi ve karakterizasyonu ile kullanılan alana göre modifikasyonları hem teorik ve hem de uygulamalı Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir.

### Malzeme Üretim

#### Vakum Ark Ergitme (Edmund Bühler, AM 200)



Saf inert gaz atmosferinde ergitme ve alaşımlama için kullanılan bir ark ergitici. Yaklaşık 200 g'a kadar numuneleri 3500°C'ye kadar sıcaklıklarda ergitmektedir. Çok amaçlı kalıplara sahip su soğutmalı bakır pota plakası (düşme ve çubuk numuneler için) bulunmaktadır. Su soğutmalı, çift duvarlı yüksek vakum haznesine sahiptir.

### Ergiyik Döndürücü (Edmund Bühler, MSP 60)



Laboratuvar ölçeğinde, yüksek vakum veya inert gaz atmosferinde, hızla katılaşmış amorf veya nano-kristalin şeritlerin Eriyik Eğirme Sistemi ile üretimini sağlamaktadır. Çalışma başına maksimum 60 g için bir sisteme sahiptir. Yüksek vakum haznesi, yüksek vakum pompalama sistemi (turbomoleküler ve difüzyon pompası) ve RF jeneratöründen oluşan komple sistemdir.

### Yüksek Vakum ve Sıcaklık Isıl İşlem Fırını (Fytronix HV-FOPT)



Mümkün olan en yüksek saflıktaki atmosferlerdeki uygulamalar için metalik başlıklı bir fırındır. Metalik ön yüklemeli fırın, elde edilebilecek en düşük çalışma basınçlarını üretmektedir. Vakum kapasitesi sayesinde en yüksek saflıkta gaz atmosferi elde edilmektedir. Kullanılan malzemeler, en yüksek sıcaklıklarda en düşük buhar basınçları için seçilmektedir.

## Spark Plazma Sinterleme Sistemi (Fytronix FY-Plasma Furnace)



İletken olmayanlar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki malzemelerin konsolidasyonu için yenilikçi ve teknolojik bir cihazdır. 10 ms'den daha kısa akım darbelerine sahip ısıtma yöntemi, yenilikçi malzemelerin geliştirilmesine ve üretilmesine olanak tanımaktadır. Sinterleme işleminin farklı sıcaklıklarda (2000 oC'ye kadar) ve kısa sürede gerçekleştirilmesi, SPS'i aşırı tane büyümesi olmadan nanokristalin ve alt mikron malzemelerin hazırlanması için ideal hale getirmektedir.

## Yataklı Jet Değirmen ve Sınıflandırıcı (NETZSCH Trockenmahltechnik GmbH / Netzsch Lab Pilot)



NETZSCH'in ince öğütücüleri ve ultra ince sınıflandırıcıları en yüksek düzeyde inceliği ve optimum verimliliği temsil eder. Uygun laboratuvar makineleriyle kanıtlanmış teknoloji, yeni ürünlerin geliştirilmesinde ve hatta laboratuvar ölçeğinde küçük miktarlarda üretim için de kullanılabilir. NETZSCH LabPilot, kapalı bir sistemde ve sürekli modda müteakip sınıflandırma aşamasıyla birlikte farklı değirmen türlerinin olası kullanımı sayesinde maksimum esneklik sunar. Bu, ürün kaybını önler, önemli ölçüde rahatlama ve zaman tasarrufu sağlar ve farklı ürünlerle hızlı test yapılmasına olanak tanır.

## Vakumlu Torpido Gözü Kombine Sistemi ile Termal Buharlaştırma ve Magnetron Püskürtme Sistemi (Fytronix FY-THRM/MAG-OPT-4GBS)



### *İleri teknoloji ile üstün film üretimi*

Dört eldivenli, 316 paslanmaz çelik duvarlı,  $O_2$  ve  $H_2O$  konsantrasyonları 1 ppm altında olan eldivenli kutu içerisinde iki pencereyi kapıya sahip vakum odasının bulunduğu sistemdir. Eldivenli kutu kombineli vakum oda içerisinde 2 termal buharlaştırma, 2 DC/RF püskürtme kaynağı ile 100 mm'lik döner ısıtmalı (3-20 rpm ve  $500^{\circ}C$ 'e çıkabilen) alt tabaka tutucusu üzerine yaklaşık  $10^{-7}$  Torr seviyelerinde biriktirme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bu sistem aynı zamanda, ayrı termal kaynakları veya püskürtme kaynaklarını çalıştırarak çok katmanlı film oluşumuna ve iki kaynaktan birlikte buharlaşmaya/püskürtmeye izin vermektedir. Tüm proses parametreleri, hepsi bir arada bir bilgisayar kullanılarak dokunmatik ekranlı bir Lab view programı ile kontrol edilen sistem ile Nd, Y, Ce, Sc, La, Gd, B, Si, Al, Ti, Zr, SiO, WO, BaF<sub>2</sub>, MgF<sub>2</sub>, TiO<sub>2</sub>, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, SiO<sub>2</sub>, TiN gibi çok katmanlı, nano boyutlu metalik, oksit, karbür veya nitrür filmler üretilebilmektedir.

## Mıknatıs Üretimi için Torpido Gözü Sistemi (Fytronix FY-GLV-6GBS-MGN)



Her bir tarafı 3 kol olmak üzere 6 kol eldivene sahip çalışma kabini, malzeme yükleme ve geri almayı sağlayan vakumlu bir transfer odası, inert gazdaki oksijen ve nem 1 ppm'in altına düşürmek için bir gaz arıtma ünitesi ve bir mikroişlemci kontrollü PLC kontrol ünitesinden oluşan bir sistemdir. Özel tasarıma sahip bu sistem, öğütülmüş NdFeB ve SmCo tozlarının koruyucu bir atmosfer altında depolanması (oksijen ve nem değerleri 1 ppm altında), manyetik alan altında preslenmesi (5 metrik ton) ve preslenmiş numunelerin sinterlenmesi için bir tarafı eldivenli kutuya monte edilmiş tüp fırından (1300°C'ye kadar) oluşmaktadır.



### Mikro Enjeksiyon Makinesi (Boy XXS SP23)



Mikro Enjeksiyon Makinesi, çeşitli karışımlarda hazırlanan takviyeli ve takviyesiz termoplastik malzemelerin özelliklerinin standartlara uygun olarak hesaplanmasını sağlayan çekme ve DMA testleri gibi numunelerin üretilmesini sağlamaktadır. Cihaz 18 mm dişli çapına sahiptir.

### Çift Vidalı Ekstruder (Gülmar Makina GM25)



Çift vidalı ekstruder, güçlendirilmiş plastiklerin üretiminde yaygın olarak kullanılan bir ekipmandır. Endüstride kullanılan mühendislik plastiklerinin geri dönüştürülmüş malzemelerle hazırlanması, kısa cam elyaf, kısa karbon elyaf veya doğal elyaf ve toz malzemeler ile güçlendirilmiş polimer matrisli kompozit malzemelerin üretimine olanak sağlar. Cihaz vida çapı 25 mm olan çift vidaya sahiptir. Ana ve yan besleme olmak üzere iki besleme ünitesinden oluşmaktadır.

## Soğuk İzostatik Presleme (Fytronix FY-100-300CIP)



Soğuk İzostatik Presleme (CIP), genellikle elastomerlerden yapılan esnek bir kalıba yerleştirilen tozları katı formlara sıkıştırmak için yüksek hidrostatik basınç kullanan, homojen yoğunluk ve gelişmiş mekanik özellikler sağlamak amacıyla tasarlanan sistemdir. Bu sistem, 100 ila 300 MPa maksimum çalışma basıncı aralığına ve 300 mm derinliğe sahip 100 mm yüksek basınçlı kabın çapına, hidrolik tahrik sistemine ve 9 kW'lık kurulu güce sahiptir. Kullanım için bir dokunmatik ekran, basınç döngüsünün hassas bir şekilde kontrol edilmesine ve izlenmesine olanak tanımaktadır. İzostatik basınç uygulaması yoluyla malzemelerin mekanik özelliklerini geliştirmek, ürün kalitesini ve performansını artırmak amacıyla havacılık, otomotiv ve elektronik gibi çeşitli uygulama alanlarında farklı ebatlara sahip ürünlerin üretilmesini sağlamaktadır.

## Torpedo gözü bölmesi (Fytronix FYT-OPT-3GBS)



Torpedo gözü bölmesi, inert gaz veya nitrojen ile dolu sızdırmaz bir ortam yaratarak aktif maddeleri uzaklaştıran bir sistem sunar.

### Sistem özellikleri:

- Yüksek Saflıkta Gaz Ortamı: Anhidroz, anaerobik veya güvenilir performans sağlar.
- Geniş Uygulama Alanı: Lityum-iyon pil, güneş hücresi, özel lamba üretimi, ince kimyasallar, OLED üretimi, süper kapasitör geliştirme ve medikal ürünlerin üretiminde kullanılır.
- Düşük Sızıntı Teknolojisi: <0.001 vol%/saat sızıntı oranı ile güvenilir performans.
- Otomatik Rejenerasyon: O<sub>2</sub> ve H<sub>2</sub>O seviyeleri belirli sınır değerlere ulaştığında sistem kendini otomatik olarak yeniler.

### Teknik özellikler:

- Boyutlar: 1500 x 750 x 900 mm
- Malzeme: Paslanmaz çelik
- Görsel Panel: 8 mm kalınlığında temperli cam
- Sızdırmazlık: Silikon sıkıştırılabilir contalar
- Filtreler: Su ve oksijen tutucu filtreler
- Saflık Seviyeleri: O<sub>2</sub> ve H<sub>2</sub>O saflığı <1 ppm

### Kontrol ve İzleme:

- Dokunmatik Ekran Kontrol Sistemi: Nem ve oksijen seviyeleri anlık olarak izlenebilir.
- Uzaktan Erişim: Seviyeler uzaktan herhangi bir lokasyondan takip edilebilir.

## Bilyalı Frezeleme (Fritsch Pulverisette 5/2)



Planetary Mill PULVERISETTE 5 klasik serisi, iki çalışma istasyonuyla, öğütme bilyelerinin özellikle yüksek enerji etkisi nedeniyle, koloidal inceliğe kadar sert, orta sert, yumuşak, kırılğan, sert malzemelerin kayıpsız öğütme sonuçlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde sunar. İstenilen son inceliğe bağlı olarak, öğütme kuru, süspansiyonda veya inert gazda gerçekleştirilebilir. Planetary Bilyalı Değirmen, öğütmenin yanı sıra malzeme araştırmalarında mekanik aktivasyon ve alaşımlama için de kullanılabilir.

- 400 rpm'ye kadar dönüş hızlarıyla hızlı parçalama
- 1  $\mu$ m'nin altında son incelik
- 2 çalışma istasyonunda son derece ince homojen öğütme
- Kaselerin Güvenli Kilit Sistemi ile güvenli şekilde gerilmesi
- 2 x 225 ml'ye kadar kullanılabilir kapasite

## Mıknatıslayıcı (Fytronix FY-MAG20)




Mıknatıslayıcı sistemi, çeşitli manyetik malzemeleri mıknatıslamak için güçlü bir manyetik alan oluşturmak üzere kapasitörlerde depolanan yüksek voltajlı enerjiyi kullanarak kapasitör deşarjı prensibine sahip sistem olarak adlandırılmaktadır. Bu sistem, önce kondansatörü yüksek bir DC voltajıyla şarj eder, ardından mıknatıslama bobini aracılığıyla hızla boşaltır ve bobin içine yerleştirilen mıknatıs malzemesini doyuran güçlü bir manyetik darbe oluşturmaktadır. Başlıca ferrit, NdFeB ve AlNiCo mıknatısların yanı sıra küçük motorlar ve hoparlörler gibi bileşenler de dahil olmak üzere birçok malzemelerin verimli ve hassas bir şekilde mıknatıslanmasını sağlayabilmektedir. 500V ile 1200V arasında sürekli ayarlanabilir bir voltaj çıkışına, 4-6 saniyelik bir mıknatıslama döngüsü süresiyle 15.000A'ya kadar bir tepe darbe akımı sağlayabilen mıknatıslayıcı sistemi 600 $\mu$ F ile 4000 $\mu$ F kapasitans kullanmakla birlikte kapasitans ayarına bağlı olarak 432J ile 2881J arasında enerji depolayabilmektedir.

## Hassas Kesim Makinası (Metkon MICRACUT 202-AX)

Yüksek hassas kesim makinesi metaller, seramikler, elektronik bileşenler, kristaller, kompozitler, biyomalzemeler, sinterlenmiş karbürler, mineraller vb. gibi malzemelerin hassas ve deformasyonsuz kesimi için kullanılır. Kesme yüzeyleri hasar ve deformasyona uğramaz böylece kesilen numuneler kısa bir parlatma işleminden sonra mikroskop altında incelenebilir. Maksimum 75 mm çap, 50 mm en ve 175 mm uzunluğu boyutlarına sahip olan numuneler kesilebilir. Cihazın 60 mm'lik kesim kursu (kesme disk taşının numune uzunluğuna dik yönde hareket kursu) boyunca, numuneler birbirine paralel şekilde programlanabilir seri kesim ve dilimler halinde dilimlendirilmesi yapılabilir. Tek işlemde otomatik olarak eşit veya farklı kalınlıklarda çok sayıda dilim alınabilir. Cihaz, birçok numune hazırlama uygulaması, farklı boyutlarda veya düzensiz şekilli parçaların cihazın uygun özel mengeneleri ile tutturulup kesilerek onlardan numune çıkartılmasını sağlar.



## Otomatik Montaj Presi (Metkon ECOPRESS 102)

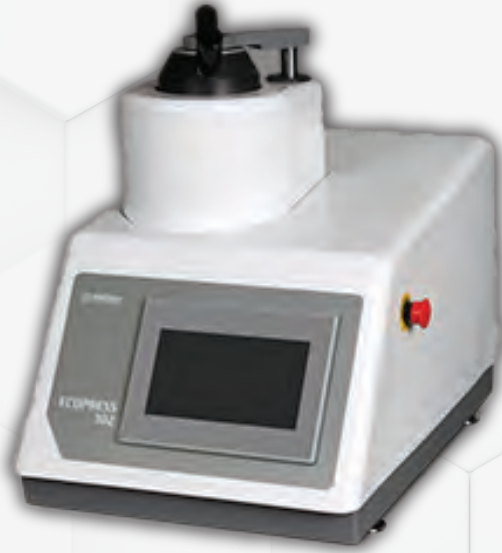

Numune kesiminin ardından sonraki işlem kalıplamadır. Yüksek kapasiteli otomatik bakalite alma-kalıplama cihazı elektro-hidrolik çalışma prensibine dayalı olarak çalışır. Tamamen otomatiktir ve materyalografide kullanılan tüm güncel sıcak montaj malzemelerine uygundur. Küçük veya düzensiz şekilli numunelerin taşınmasını kolaylaştırır ve hazırlama işlemi sırasında hassas malzemeleri, ince katmanları veya kaplamaları korur. Mevcut kalıp çapı 40 mm'dir ve 25 mm'den 50 mm'ye kadar çeşitli çaptaki kalıpların kullanımı için uygun olup kalıp değiştirme işlemi kolay ve çabuktur. Tamamen elektrohidrolik basınç ve tahrik sistemi (hava gerekmez), 300 bar' a kadar kalıplama basıncı, 200°C' ye kadar sıcaklık ayarlama imkânı vardır.

## Elektroeğirme Sistemi (Fytronix ES-9000)



Yüksek elektrik alan içinde polimer çözeltilerinden nanolif (nanofiber) malzeme üretilmesini sağlayan sistemdir. Çoklu ya da tekli şırınga pompaları, tekli ve co-axial opsiyonlu nozzle kullanımına uygundur. Yatay, dikey ve döner silindir toplama üniteleri mevcuttur.

- Çalışma voltajı: 1-30 kV

## Yüksek Basınç Reaktörü (Fytronix FYHD-8000)



Toz, nanotoz malzemelerin sentezlenmesi, mikroyapı veya nanoyapıdaki ince film sentezi için kullanılan çelik kaplı sistemdir.

- Reaksiyon sıcaklığı: 24 – 250°C
- Kullanılan kaplar: 100 ml Teflon ya da siyah karbon

### X-ışını Fotoelektron Spektrometresi (XPS, ThermoFisher Scientific ESCALAB QXi)

X-ışını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS), malzemelerin yüzeylerinin kimyasal bileşimini ve elektronik durumlarını karakterize etmek için kullanılan güçlü bir analitik tekniktir. XPS cihazı, örneğe düşük enerjili X-ışınları göndererek yüzeyden fotoelektronların salınmasını sağlar. Salınan elektronların kinetik enerjisi ve yoğunluğunu analiz ederek, XPS yüzeydeki elementlerin bileşimi, kimyasal durumları ve yüzey kirliliği hakkında ayrıntılı bilgi sunar.

Bu teknik, malzeme bilimi, nanoteknoloji ve yüzey mühendisliği gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmakta olup, yüzey analizi, ince film karakterizasyonu ve yüzeydeki kimyasal reaksiyonların incelenmesi gibi uygulamalarda önemlidir. XPS, gelişmiş teknoloji uygulamalarında malzeme özelliklerini anlamak ve performansı optimize etmek için temel bir araçtır.



### Titreşimli Numune Manyetometresi (VSM, Cryogenic 9T CFMS)



Titreşen örnek manyetometresi (VSM) cihazı, elektriksel ölçüm problemleri yardımıyla, malzemelerin temel manyetik özelliklerini (uygulanan manyetik alana, sıcaklığa bağlı olarak değişimini), eğrilerini, direnç değerlerini ve Hall etkisi ölçümlerine olanak veren bir fiziksel karakterizasyon cihazıdır.

Munzur Üniversitesi Aktuluk  
Yerleşkesi Tunceli 62000  
**[munteam@munzur.edu.tr](mailto:munteam@munzur.edu.tr)**  
Tel: +904282131794

Numune Kabul Birimi:  
**[numunekabul@munzur.edu.tr](mailto:numunekabul@munzur.edu.tr)**

## The image features a repeating pattern of light gray hexagons on a white background. The hexagons are arranged in a staggered grid. Overlaid on this pattern are horizontal blue lines, which are evenly spaced and span the width of the image. The lines are thin and have a consistent color throughout.

[www.munzur.edu.tr](http://www.munzur.edu.tr)

[www.reeturkiye.com](http://www.reeturkiye.com)



*Bu yayın Avrupa Birliđi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteđiyle üretilmiřtir. Yayının içeriđinden sadece WYG Türkiye sorumlu olup, hiđbir řekilde Avrupa Birliđi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıttıđı řeklinde yorumlanamaz.*



T.C.

## MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Munzur Üniversitesi Aktuluk Yerleşkesi Merkez/Tunceli

Numune Kabul Birimi İletişim Tel : www.munzur.edu.tr  
numunekabul@munzur.edu.tr munteam@munzur.edu.tr

MUNTEAM

Başvuru No.

## ANALİZ VE TEST İSTEK FORMU

## MÜŞTERİ BİLGİLERİ (Başvuru yapan tarafından doldurulacaktır.)

|                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Analiz/Test Raporu İçin Bilgiler (Müşteri)</b>                  |                                                                 | <b>Fatura Bilgileri</b> (Adına Fatura düzenlenecektir.)                                                                               |  |
| Şahıs (Adı Soyadı) :<br>veya :<br>Firma/Kurum (Adı)                |                                                                 | Müşteri Bilgileri ile aynı ise işaretleyiniz. <input type="checkbox"/> Şahıs (Adı Soyadı) :<br>veya :<br>Firma/Kurum (Adı)            |  |
| Adres :                                                            |                                                                 | Adres :                                                                                                                               |  |
| Telefon :                                                          | Faks:                                                           | Vergi Dairesi/Vergi No. :                                                                                                             |  |
| e-posta :                                                          |                                                                 | T.C. Kimlik No. :<br>Fatura Teslimatı: <input type="checkbox"/> Elden <input type="checkbox"/> Posta <input type="checkbox"/> e-posta |  |
| <b>Analiz/Test Raporu Teslimatı</b> <input type="checkbox"/> Elden | <input type="checkbox"/> Posta <input type="checkbox"/> e-posta | <b>İngilizce Analiz/Test Raporu</b> : <input type="checkbox"/> İstiyorum (Ücretlidir) <input type="checkbox"/> İstemiyorum            |  |

## NUMUNE BİLGİLERİ (Başvuru yapan tarafından doldurulacaktır.)

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numune Alma Tarihi:</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Numune Teslim Şekli:</b>                                                                                     |
| <b>Numune Sayısı</b> :                                                                                                                                                                                                                                      | (Kargo veya posta ile numune gönderirken, dekont ve Analiz ve Test İstek Formu da beraberinde gönderilmelidir.) |
| <b>Numunenin Tanımı:</b> <input type="checkbox"/> Toprak <input type="checkbox"/> Kayaç <input type="checkbox"/> Doğal Taş                                                                                                                                  | <b>Mühür Durumu:</b> <input type="checkbox"/> Mühürlü <input type="checkbox"/> Mühürsüz                         |
| <input type="checkbox"/> Kömür <input type="checkbox"/> Sıvı <input type="checkbox"/> İşlem Görmüş                                                                                                                                                          | <b>Mühür Numarası:</b>                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Karot <input type="checkbox"/> Diğer.....                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
| <b>Sıvı Numunesi:</b> <input type="checkbox"/> Asitsiz <input type="checkbox"/> Asitli <input type="checkbox"/> Asit Türü:.....                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| <b>Açıklamalar</b> (Varsa belirtilmek istenilen diğer bilgiler) :                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
| Kurumunuza teslim edilen numune(ler)de istenen analizlerin/testlerin, Munzur Üniversitesi internet sayfasında yayınlanan Test ve Analiz Kataloğu'nda yer alan işleyişe/şartlara göre yapılmasını kabul ettiğimi beyan ve taahhüt eder, gereğini arz ederim. |                                                                                                                 |
| <b>Başvuru Tarihi</b> :                                                                                                                                                                                                                                     | <b>İMZA</b>                                                                                                     |
| <b>Başvuruyu Yapan</b> :                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |

| NUMUNE KAYIT NO.<br>(MUNTEAM tarafından doldurulacaktır.) | NUMUNE İŞARETİ<br>(Başvuru yapan tarafından doldurulacaktır.) | İSTENEN ANALİZ/TEST KODU/ADI<br>(Başvuru yapan tarafından doldurulacaktır.) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                               |                                                                             |
|                                                           |                                                               |                                                                             |
|                                                           |                                                               |                                                                             |
|                                                           |                                                               |                                                                             |
|                                                           |                                                               |                                                                             |

## NUMUNE KABUL BİLGİLERİ (MUNTEAM tarafından doldurulacaktır.)

|                                                                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Numune(lerin) Kabul Durumu</b> : <input type="checkbox"/> Kabul <input type="checkbox"/> Şartlı Kabul | <b>Numune(lerin) Gönderildiği Lab.:</b> |
| <b>Şartlı Kabul Sebebi</b> :                                                                             | <b>Numune Kabul Tarihi</b> :            |
| <b>Ücret</b> :                                                                                           | <b>Numune Kabul Sorumlusu</b> :         |
| <b>Ödeme Belge No.</b> :                                                                                 |                                         |

## NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BANKA HESAPLARI

T.C. ZİRAAT BANKASI  
Şube Kodu-Adı: 298-Tunceli Şubesi Hesap No: 71774522  
IBAN : TR370001000298717745225005

## Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Deney Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme MUNTEAM ile Müşteri arasındaki Hizmet Sözleşmesidir. MUNTEAM’da hizmet talebinde bulunan tüm kişi ve kuruluşlar “MÜŞTERİ”, Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ise “MUNTEAM” olarak adlandırılmıştır.

1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin MUNTEAM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan MUNTEAM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu MUNTEAM tarafından kabul edilmez ve konu ile ilgili bilgilendirme yapılır. MUNTEAM’ın numune kabul kriterlerine uygun ancak ilgili standardın numune kriterlerine uygun olmayan başvurular için Akredite Deney Raporu düzenlenmez.
4. Mühürlü numune(lerin) mührü, kurşundan, kırmızı mumdan veya plastikten olmalı ve gönderen Kurumun/Firmanın soğuk damgasını/numarasını/işaretini taşımalıdır. Mühürlerin kolayca çıkarılıp takılamayacak şekilde numuneye(lere) bağlanması ve gevşek olmaması gerekmektedir.
5. Müşteri, numuneleri 01’den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
6. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz ve Test İstek Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.
7. Analiz ve Test İstek Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
8. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde ([www.munzur.edu.tr](http://www.munzur.edu.tr)) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
9. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden MUNTEAM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
10. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarında hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.
11. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir.
12. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir.
13. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge MUNTEAM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez.
14. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
15. Müşteri, deney sonuçlarının sadece deneyi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda MUNZUR ÜNİVERSİTESİ’nin adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün MUNZUR ÜNİVERSİTESİ tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
16. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir.
17. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir.
18. Deneyle ilgili tüm kayıtlar/veriler, yasal bir zorunlulukla belirlenmediği sürece, müşteri gizliliği dikkate alınarak beş yıl süre ile saklanır. Beş yıldan sonra deneylerle ilgili kayıt/verilerin saklanma zorunluluğu bulunmamaktadır.
19. MUNTEAM, müşteri bilgilerinin üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını bu sözleşme ile güvence altına alır. Ancak kanun veya mevzuat gereği yasal otorite müşteriye ait bilgilere ulaşmak isterse, bilgiler paylaşılmadan önce müşteri bilgilendirilir.
20. MUNTEAM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri MUNTEAM tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. MUNTEAM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz ve Test İstek Formu’nda belirtilen proje şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar MUNTEAM tarafından tanzim edilen işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir.
21. Anlaşmazlık durumlarında Tunceli Mahkemeleri yetkilidir.

**BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DENEY HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.**

**YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA**